





Ready to improve?

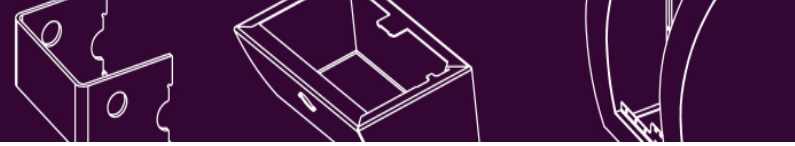


SC1310/1330


SC1320/1340

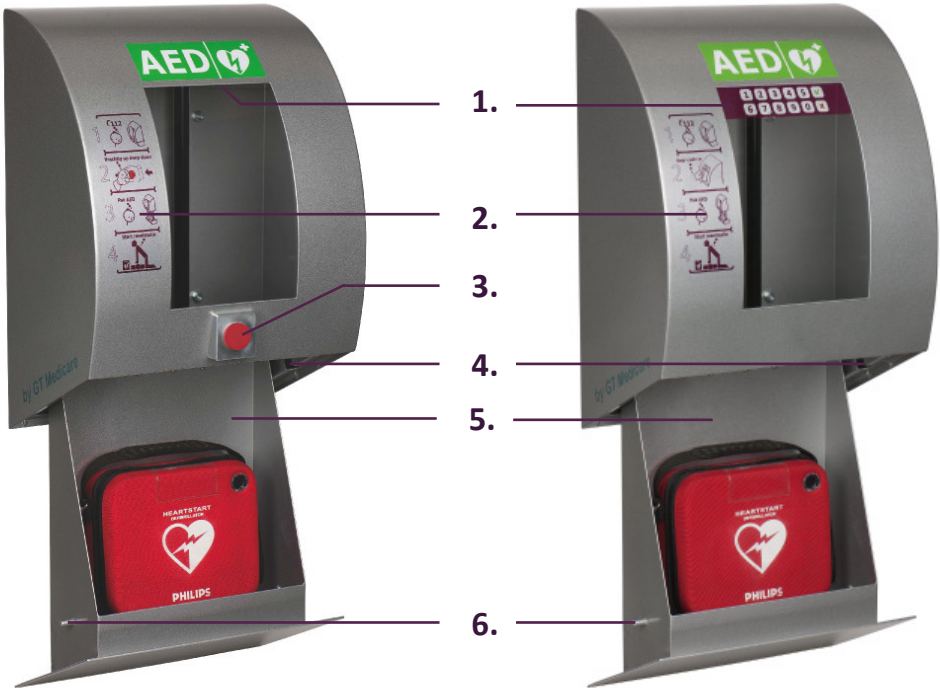

Control Unit

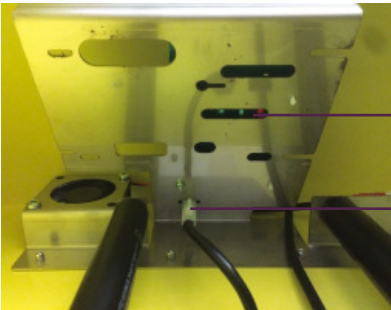

Control Unit

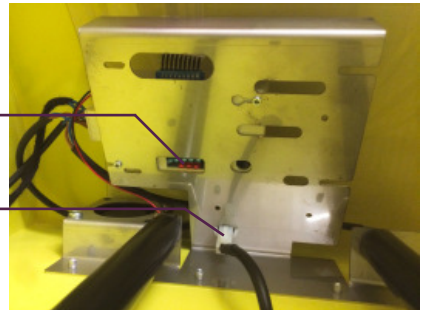


7.

8.



SC1420

SC1435

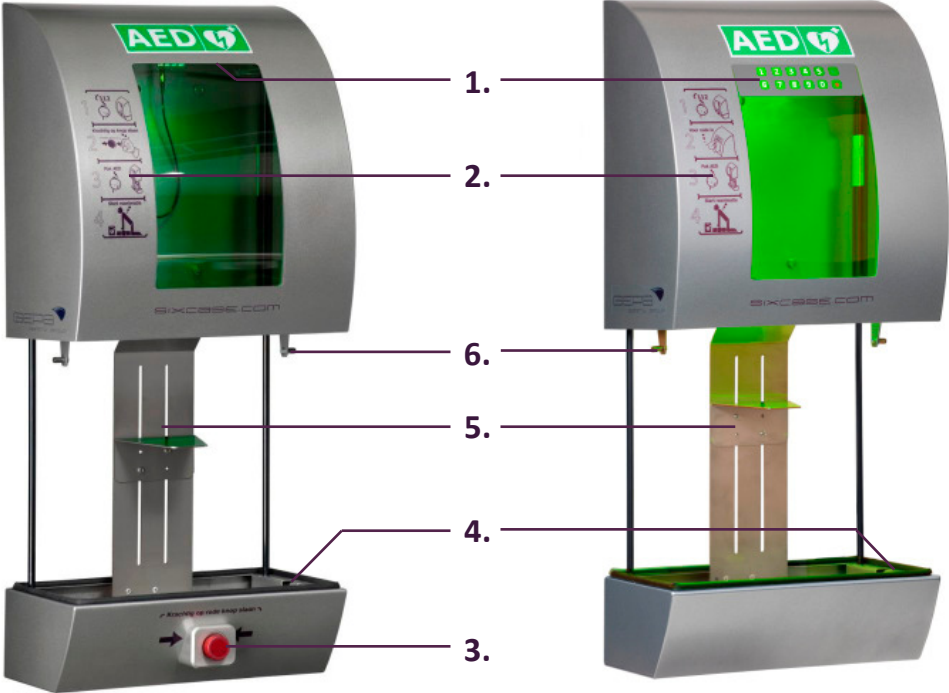



Indholdsfortegnelse

Hvad er SixCase?	3
Generel beskrivelse	3
Af sikkerhedshensyn	4
Forstyrrelser	4
Tilbehør	4
Vigtigt	4
Garanti	4
Produktoversigt	5
SixCase omfatter følgende underdele	5
Monteringsvejledning	5
Vigtigt	5
Installation i sten eller beton	5
Strømledning	5
Pas på	5
Installation i træ	5
Fastgørelse af SixCase:	6
Brug	6
I nødstilfælde (brug af AED)	6
Advarsel	6
Vedligeholdelse og fejlfinding	6
Vedligeholdelse	6
Vigtigt	6
Temperatur	6
Programmering af kode	6
Fejlfinding	7
Ordliste	8

Hvad er SixCase?

AED (Automatisk Ekstern Defibrillator) er i tidens løb blevet et vigtigt Førstehjælpsudstyr. Det er derfor afgørende at opbevare AED på et sikkert og forsvarligt sted, hvor den samtidig er tilgængelig døgnet rundt.

SixCase vægskabet giver optimal beskyttelse og sørger samtidig for at AED er tilgængelig og brugsklar døgnet rundt. Det unikke SM- modul anvender moderne kommunikationsmidler (GSM, SMS) til styring af Sixcase vægskabet.

Skabets unikke og vandbestandige design sørger for forsvarlig beskyttelse af AED. Derudover er SixCase også udstyret med en temperatursensor til beskyttelse under ekstreme vejrforhold og til opretholdelse af den rette temperatur for AED.

Generel beskrivelse



Se side 1 og 2.

1. Styreenhed (med LED lys, alarm og ventilator. Touchpad til pinkode (kun til SC1435, SC1320, SC1340))
2. Instruktioner
3. Rød trykknop
4. Rotor Latch låsesystem (til højre)
5. AED holder (med varme SC1330, SC1340, SC1415, SC1420, SC1435)
6. Låsetap
7. LED lys
8. Strømledning



Af sikkerhedshensyn

Læs instruktionerne grundigt igennem. Det kan være farligt eller ulovligt ikke at følge instruktionerne. Læs hele brugsanvisningen igennem for yderligere oplysninger.

		Symbol
Fare:	Faresymbolet gør opmærksom på handlinger eller situationer, som kan resultere i personskade.	
Advarsel:	Faresymbolet gør opmærksom på handlinger eller situationer, som kan resultere i skade på apparatet eller omgivelserne.	

Forstyrrelser

Alle trådløse apparater kan forårsage forstyrrelser. Dette kan have en negativ effekt på apparatet.

Tilbehør

Anvend udelukkende godkendt tilbehør. Undgå at tilslutte tilbehør som ikke er kompatibelt.

Vigtigt

SixCase er ikke ansvarlig for indholdet i dette dokument og heller ikke for tab af informationer, indtægter og/eller direkte eller indirekte skade, uanset hvad der har forårsaget dette.

SixCase forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre dokumentet uden forudgående tilkendegivelse, gældende for alle produkter publiceret i denne brugsanvisning.

Indholdet i dette dokument er ikke dækket af nogen form for garanti. Det samme gælder også for tilbehør til dette produkt.

Garanti

- GT MEDICARE apparater leveres med en garanti på 60 måneder på alle vægskabets mekaniske dele. Ridser og beskadigelser dækkes ikke af garantien. Garantien på elektronik og øvrige produkter fra GT Medicare er 24 måneder at regne fra leveringsdatoen, og GT MEDICARE's garantibestemmelser i Holland anvendes. Producenten skal kunne opfylde forpligtelserne i medfør af disse garantibestemmelser. Producenten bærer ikke ansvaret for indirekte skade og følgeskade. I alle tilfælde er producentens ansvar begrænset til salgsprisen på de solgte produkter.
- Hvis et skadestilfælde er resultatet af en ændring eller ukundig brug af det i kontrakten beskrevne produkt, finder garantibestemmelserne under ingen omstændigheder anvendelig.
- Enhver forsendelse af apparatur skal undersøges at modtageren straks efter modtagelse. Kunden skal senest ti (10) dage efter modtagelse skriftligt informere GT MEDICARE om alle mangler ved forsendelsen. Hvis disse mangler ikke senest ti (10) dage efter modtagelse er blevet anmeldt, er forsendelsen af begge parter at betragte som komplet. For skjulte mangler, som skal bevises af kunden, gælder, at det kun er muligt at fremsætte reklamation inden for garantiperioden. Såfremt en reklamation af GT MEDICARE bliver betragtet som velbegrunnet, er GT MEDICARE kun forpligtet til at udskifte eller reparere de defekte varer, uden at kunden derudover er berettiget til at fremsætte noget krav om godtgørelse. Fremsættelse af en reklamation fritager ikke kunden for pligten til at betale.



Produktoversigt

SixCase omfatter følgende underdele

- **SixCase AED vægskab**
- **Nøgle** (Valgfri)
- **24V Adapter** (SC1320/ 1330/ 1340/ 1415/ 1420/ 1435)
- **Strømledning 3m** (SC1320/ 1330/ 1340/ 1415/ 1420/ 1435)
- **Monteringsvejledning**
- **Opvarmning** (SC1320/ 1330/ 1340/ 1415/ 1420/ 1435)
- **GSM Modul** (SMS info pack)
- **Plugs** (4x)
- **Gevindspindel** (4x)
- **Afstandsbojsninger** (4x)
- **Underlagsskiver** (4x)
- **Møtrikker** (4x)

Monteringsvejledning

Vigtigt

Det er afgørende at skabet installeres korrekt. Installationen falder udenfor SixCases ansvarsområde. Det leverede monteringsmateriale er udelukkende beregnet til installation på vægge fremstillet af flade massivt træ, sten, beton eller metalplader med en tykkelse på mindst 3 mm. Det frarådes at installere SixCase på lettere metaltyper som for eksempel aluminium. Brug altid de medfølgende afstandsbojsninger.

Installationstip! For bedre at kunne regulere temperaturen i skabet og for at forlænge skabets og AED'ens levetid, anbefaler vi at installere SixCase i skyggen.

Installation i sten eller beton

Anbring den vedlagte skabelon (A4 format) på væggen, og afmærk hullerne. Bor hullerne på $\varnothing 10$ mm i en dybde på mindst 6 cm (60 mm), for at skabe tilstrækkelig dybde

til en plug eller kemisk mørtel. Den anbefalede højde for de øverste huller er cirka 1,5 m. Hullerne skal altid bores i midten af stenen.

Installationstip Boltenden kan skrues fast i muren under den rette forspænding ved hjælp af en drejningsmomentnøgle. Boltenden skal fastgøres i muren på det metriske gevind M8.

Strømledning

SixCase anbefaler også at bore det midterste hul ($\varnothing 12$ mm), så du kan føre strømledningen gennem muren. Der leveres standard en adapter og 3 m strømledning. Strømledningen kan fastgøres på adapteren ved hjælp af en konnekter. Denne konnekter passer igennem et hul på $\varnothing 12$ mm. Det er vigtigt at adapteren anbringes i ejendommen.

Det er vigtigt at føre strømledningen gennem muren, før SixCase skabet ophænges. Ledningen er udstyret med koblingsspindel, hvormed ledningen kan fastgøres i forhold til SixCase. Før ledningen udefra og ind igennem/over væggen indtil koblingsspindlen sidder op imod væggen. Derefter kan SixCase hænges op på væggen og ledningen kan føres igennem det midterste hul. Drej plastikmøtrikken fast indefra og klik konnekteren fast for oven i modulpladen, hvorefter SixCase er tilsluttet.

Pas på

Hvis det viser sig at væggen ikke er stærk nok til at kunne bære SixCase med en plug, anbefaler vi Fischer VS 100 P. Det er nok at skrue skruen fast (uden plug) i mørtlen. Se brugsanvisningen på Fischer VS 100 P pakken. Sørg for at rense hullerne grundigt (1x blæse, 1x børste, 1x blæse, 1x børste) før du anbringer pluggen eller den kemiske mørtel i hullet.

Installation i træ

Bor - ved hjælp af den leverede skabelon - små huller på $\varnothing 4$ mm i træet, og skru derefter gevindskrueerne fast i træet, lad M8 gevindenden stikke maks. 30 mm ud. Den anbefalede højde for de øverste huller er cirka 1,5 m. For



enden af M8 gevindstangen kan der anbringes en nøgle, så skruen kan drejes ind i træet med den rette forspænding.

Fastgørelse af SixCase

Hæng skabet på gevindstangen, som du netop har fastgjort i væggen. Fastgør SixCase ved at skrue de vedlagte M8 møtrikker med afstandsskiver på indersiden fast ved hjælp af nøgle 13. Advarsel! Pas på at du ikke klemmer adapter-ledningen!

Brug

Sæt hænderne på venstre og på højre side, under den nederste del af skabet og tryk den opad. Skabet er rigtigt lukket, når der høres et tydeligt klik fra begge lukkemekanismer.



I nødstilfælde (brug af AED)

SC1310: Slå på den røde knap (som beskrevet på etiketten med instrukser), vent til den nederste del af skabet er i nederste position og tag AED ud.

SC1415: Sæt nøglen i højre side af den nederste del (som beskrevet i etiketten med instrukser) og drej den kraftigt højre om. Vent til den nederste del af skabet er i nederste position og tag AED ud.

SC1420: Slå på den røde knap (som beskrevet på etiketten med instrukser), vent til den nederste del af skabet er i nederste position og tag AED ud.

SC1320/ 1340/ 1435: Indtast den programmerede kode eller sæt nøglen i højre side af den nederste del (som beskrevet i etiketten med instrukser) og drej den kraftigt højre om. Vent til den nederste del af skabet er i nederste position og tag AED ud (du skal altid have både koden og nøglen ved hånden i nødstilfælde).



Advarsel

Du skal altid have koden, nøglen eller SMS koden ved hånden i nødstilfælde. På grund af en uventet defekt kan det ske, at en af åbningsmetoderne ikke fungerer.

er. I så tilfælde skal du have en alternativ metode. Det er vigtigt at øve åbningsprocedurerne, før AED monteres, men også derefter.

Vedligeholdelse og fejlfinding



Vedligeholdelse

Det er vigtigt at kontrollere skabets funktion hver uge (åbnes), herunder trykknappen eller touchpad til pinkode, låsesystem, nøglecylinder og om nødvendigt, smøre låsens dele igen (kugleleje-fedt eller multi grease). Når den røde knap er trykket ind, nøglen er sat i eller den programmerede kode er indtastet, skal den nederste del af skabet let bevæge sig nedad til nederste position, således at AED kan tages ud. Om muligt kontrolleres også status for AED i henhold til den medfølgende vejledning. Hvis der konstateres en defekt, anbefaler vi, at du straks kontakter forhandleren eller fabrikanten SixCase. Afhængig af defekten anbefaler vi, at AED (midlertidigt) sættes ud af funktion.

Vigtigt

For at kunne garantere, at SixCase fungerer korrekt, er det kun tilladt at bruge godkendte dele.

Temperatur

Hvis du tvivler på, om varmen fungerer korrekt (ved temperaturer på under 0°C (32°F)), anbefaler vi at tage AED ud og kontakte forhandleren.

Skabene SC1330/ 1340/ 1415/ 1420/ 1435 er udstyret med et aktivt ventilationssystem. Ved en indvendig temperatur på ca. 30°C starter ventilatoren og bortleder varm luft. Via en ventilationsåbning i den nederste del af skabet suges kølig luft ind, så høje temperaturer så vidt muligt undgås. Ved temperaturer på over 50°C anbefaler vi, at AED tages ud.

Programmering af kode

Standard er koden til åbning af SixCase indstillet på: 1234
Ændring af pinkoden:



Åbn SixCase vægskabet ved hjælp af nøglen eller den allerede indstillede pinkode (1234). Indtast koden 1245 for at ændre pinkoden, alarmen stopper.


Indtast den ny pinkode og bekræft den med det grønne V. Alarmen høres igen.

Nu er pinkoden ændret.

Advarsel: Kontroller altid den ændrede pinkode ved at åbne SixCase AED-vægskabet med den nye pinkode.

Udskiftning af rudeglas

Rudeglasset udskiftes ved at åbne SixCase og tage AED ud af SixCase, så du tydeligt kan se låsen på indersiden af skabet. Lige foran AED kan du se en låsebolt til sikring af låsen. Ved at trække den opad i ringen eller knappen låses den røde knap op, så den nemt kan tages ud. Eventuelle glasrester fjernes, før det nye rudeglas sættes i. Når det nye glas er sat i, kan låsen sættes i igen i omvendt rækkefølge. Med nøglen kontrolleres, om låsen fungerer korrekt (begge låse betjenes), før skabet lukkes. Rudeglasset er udskiftet.

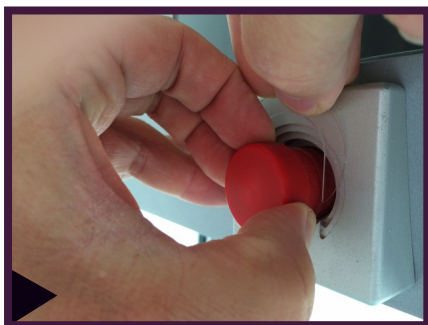

Fejlfinding

Defekt	Handling
LED lys lyser ikke	Kontroller, om strømmen er rigtigt koblet til (strømledning og adapter) Mål, om der er strøm i skabet (12 eller 24 Volt) Hvis fejlen ikke kan afhjælpes, anbefaler vi at skabet og eventuelt AED sættes ud af funktion og, at forhandleren eller SixCase kontaktes.
Touchpad til pinkode reagerer ikke på indtastning	Kontroller, om strømmen er rigtigt koblet til (strømledning og adapter) Mål, om der er strøm i skabet (12 eller 24 Volt) Hvis fejlen ikke kan afhjælpes, anbefaler vi at skabet og eventuelt AED sættes ud af funktion og at forhandleren eller SixCase kontaktes.



Skabet lukker ikke korrekt	Åbn skabet manuelt eller ved hjælp af koden. Sæt hænderne til venstre og til højre under den nederste del af skabet og tryk det opad. Skabet er rigtigt lukket, når der høres et tydeligt klik fra begge lukkemekanismer. Hvis fejlen ikke kan afhjælpes, anbefaler vi at skabet og eventuelt AED sættes ud af funktion og, at forhandleren eller SixCase kontaktes.
Skabet åbner ikke helt (én side) (SC1310/1330/ 1420)	Luk skabet (ifølge ovenstående procedure) Slå hårdere på den røde knap. Hvis fejlen ikke kan afhjælpes, anbefaler vi at skabet og eventuelt AED sættes ud af funktion og, at forhandleren eller SixCase kontaktes.
Touchpad til pinkode reagerer korrekt, men skabet åbner ikke helt (SC1320/ 1340/ 1435)	Udøv noget tryk på den nederste del af skabet. Hvis skabet ikke åbner, lukkes skabet igen. Vi anbefaler at skabet og eventuelt AED sættes ud af funktion og, at forhandleren eller SixCase kontaktes.
Rød trykknop kan trykkes ind, men skabet åbner ikke helt (én side) (SC1310/1330/ 1420)	Udøv noget tryk på den nederste del af skabet. Hvis skabet ikke åbner, lukkes skabet igen. Vi anbefaler at skabet og eventuelt AED sættes ud af funktion og, at forhandleren eller SixCase kontaktes.

Ordliste

AED

AED (Automatic External Defibrillator) er et bærbart apparat der anvendes på personer med hjertestop. Ved at tildele elektriske chok forsøger man at genoprette den normale hjerterytme.

Forvalter

Dette er SixCase skabets hovedbruger. Denne person har adgang til brugerprofilen og sørger for vedligeholdelsen af AED skabet.

GSM

Global System for Mobile communications: afledt af Groupe Special Mobile, er den mest brugte standard for mobiltelefoner i verden.

SMS

Short Message Service (SMS) er en kommunikationsprotokol som muliggør udveksling af tekstbeskeder mellem mobile telefoner.

Online service

For yderligere information eller online-service, henvises til vores hjemmeside www.sixcase.com.



Brugsanvisning: Online brugsanvisningen indeholder den nyeste information til SixCase. Opdateringer publiceres på websitet.

Disclaimer: GT Medicare/ SixCase.com er på ingen måde ansvarlig for installationen, kommunikationen og brugen af SixCase AED skabet og/ eller for tredjeparters skade.

Kontakt

GT Medicare BV
Bargelaan 6
2333 CT Leiden
Holland
T +031 (0) 71 2100 229
E info@sixcase.com



Sisällysluettelo

Mikä SixCase on?	9
Yleiskuvaus	9
Oma turvallisuutesi	10
Merkinnät	10
Viat	10
Tärkeää	10
Takuu	10
Tuotteen tiedot lyhyesti	11
Mitä SixCase sisältää?	11
Asennus	11
Tärkeää	11
Asentaminen tiili- tai betoniseinään	11
Syöttökaapeli	12
Ole varovainen	12
Asentaminen puuseinän	12
SixCase-kaapin kiinnittäminen	12
Käyttö	12
Hätätilanteet (AED:n käyttö)	12
Tärkeää	12
Huolto ja vianetsintä	12
Huolto	12
Lämpötila	13
Koodin vaihtaminen	13
Hätäpainikkeen lasin vaihtaminen	13
Vianetsintä	14
Sanasto	15

Mikä SixCase on?

AED eli puoliautomaattinen defibrillaattori on tärkeä apuväline sydämenpysähdyksen ensihoidossa. On erittäin tärkeää, että AED-defibrillaattori on hyvin suojattu ja heti saatavilla hätätilanteessa joka päivä kaikkina vuorokaudenaikoina. SixCase-kaappi suojaa defibrillaattoria parhaalla mahdollisella tavalla ja varmistaa, että se on aina saatavilla. Ainutlaatuinen SMS-moduuli käyttää kaikkia nykyisiä viestintämenetelmiä.

SixCase-ulkokaappi on suunniteltu suojaamaan AED-defibrillaattoria äärimmäisissä sääolosuhteissa. Kaappi kestää vettä ja suojaa defibrillaattoria ilkeiltä. Siinä yhdistyvät toimivuus ja moderni suunnittelu. Ruostumaton teräs tai alumiini on leikattu laserilla ja hitsattu käyttämällä robotia. Defibrillaattori näkyy selkeästi polykarbonaatti-ikkunan lävitse. Kaksi hydraulista säädintä laskee AED:n kannattimen alaosan alas, kun lukko on avattu. Ulkokäyttöön tarkoitettussa SixCase-kaapissa on lämpötilan ilmaisimien ja lämmitin, jotta lämpötila pysyy yli 0 °C:ssa. SixCase-kaapin lukko toimii samalla periaatteella kuin auton lukko, ja se on todistetusti turvallinen ja kestävä.

Yleiskuvaus

Katso sivu 1 ja 2.

1. Ohjausyksikkö (LED-valot, summeri ja tuuletin). PIN-koodinäppäimistö (vain SC1435, SC1320, SC1340))
2. Turvaohjeet
3. Punainen painonappi
4. Jousilukkojärjestelmä (oikea)
5. AED:n kannatin (sisältää lämmittimen SC1330, SC1340, SC1415, SC1420, SC1435)
6. Lukitustappi
7. LED-valot
8. Virtajohto



Oma turvallisuutesi

Merkinnyt

Lue käyttöopas huolellisesti. Kaikkien käyttäjien on perehdyttävä näihin turvallisuusohjeisiin ennen SixCase AED -kaapin käyttöönottoa. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi olla vaarallista tai lainvastaista. Noudata kaikkia suositeltuja huolto-ohjeita. Ota ongelmatilanteessa heti yhteys huoltoon. Älä käytä laitetta, ennen kuin koulutettu henkilöstö on tarkastanut sen.

		Symboli
Varoitus	Varoitus ilmoittaa tilanteista tai toimista, jotka voivat aiheuttaa henkilövahinkoja tai kuoleman.	
Tärkeä huomautus:	Tärkeät huomautukset ilmoittavat tilanteista tai toimista, jotka voivat vaurioittaa laitetta.	

Viat

Kaikki langattomat laitteet voivat olla herkkiä häiriöille. Ne voivat vaikuttaa laitteen toimintaan. Käytä ja liitä vain yhteensopivia laitteita, jotka SixCase.com on hyväksynyt.

Tärkeää

SixCase ei ole vastuussa tämän asiakirjan sisällöstä eikä tietojen tai ansioiden menetyksestä tai suoraan tai epäsuorasti aiheutuneista vahingoista. SixCase pidättää oikeuden muokata ja parantaa tätä asiakirjaa ja kaikkia tässä käyttöoppaassa mainittuja tuotteita ilman ennalta annettua ilmoitusta. Tämän asiakirjan sisällöstä ei anneta minkäänlaisia takuita.

Takuu

- GT MEDICARE vastaa palvelujen laadusta ja toimittujen tuotteiden kunnosta ja hyvästä laadusta parhaan tietämyksensä mukaan sillä varauksella, että takuu ei ylitä seuraavassa mainittuja ehtoja.
- Jos viat ovat ostajan aiheuttamia, ostaja maksaa korjaus- ja lähetyskulut.
- Ostajalla ei ole oikeutta takuuseen seuraavissa tapauksissa:

A: Ostaja ei ole huolehtinut uotteista asianmukaisesti.

B: Ostaja on teettänyt tuotteisiin muutoksia tai korjauksia, joita ei ole tehty GT MEDICAREN oimeksiannosta tai sen valtuuttamana.

C: Virheellinen tai huolimaton käyttö, väärä liitäntä, väärä jännite, salama tai kosteuden, muiden ulkoisten laitteiden tai onnettomuuksien aiheuttama vaurio.

D: Laitetta ei ole huollettu asianmukaisesti tai viipymättä ohjeiden mukaan.

E: Laitetta käytetään tarkoitettua huonompien tai väärin lisävarusteiden kanssa.

F: Ostaja on käsitellyt tuotteita huolimattomasti.

- GT MEDICARE takaa, että tuotteissa ei ole vakavia puutteita toimitusajankohtana.
- Jälleenmyyjä ilmoittaa GT MEDICARElle kirjallisesti 10 päivän kuluessa tuotteiden vastaanottamisesta, jos tuotteissa on kohtuudella havaittavia puutteita tai vaurioita tai jos tuotteet eivät ole vaatimusten mukaisia. Jälleenmyyjä ilmoittaa kaikista muista puutteista kirjallisesti GT MEDICARElle vuoden kuluessa toimituspäivästä. Vaatimuksia vastaanattomilta tai vaurioituneilta vaikuttavat tuotteet tulee palauttaa GT MEDICARElle heti tarkastettaviksi. Vaateita, joita ei ole ilmoitettu tämän kohdan ehtojen mukaisesti, ei hyväksytä. Jos GT MEDICARE



on vastuussa siitä, että tuote ei ole vaatimusten mukainen tai on vaurioitunut, yhtä oman harkintansa mukaan korjaa tuotteet, vaihtaa ne uusiin tai palauttaa tuotteiden ostohinnan. GT MEDICARElla ei ole edellisessä lauseessa mainittujen lisäksi muita velvoitteita tai vastuita jälleenmyyjää kohtaan vaurioituneiden tai vaatimuksia vastaamattomien tuotteiden osalta.

6. Takuu-aika seinäkaappien osalta on 60 kuukautta tämän ehdon ulkopuolelle jääviä kaapin ja ikkunan naarmuja ja vaurioita lukuun ottamatta sekä elektroniikan osalta 24 kuukautta toimitusajankohdasta. Valmistaja on vastuussa vain tähän takuuseen sisältyvien velvoitteiden suorittamisesta. Valmistaja ei ole vastuussa epäsuorista tai välillisistä vahingoista. Valmistajan korvausvastuu rajoittuu kaikissa tapauksissa tuotteiden myyntihintaan.
7. Jos korvausvaade aiheutuu sopimuksessa kuvattuun tuotteeseen tehdyistä muutoksista tai tuotteen virheellisestä käytöstä, takuu ei ole voimassa missään olosuhteissa.
8. Vastaanottaja tarkastaa kaikki vastaanotetut tuotteet heti. Asiakkaan täytyy ilmoittaa GT MEDICARElle kirjallisesti kaikista lähetyksessä havaituista puutteista kymmenen (10) päivän kuluessa tuotteiden vastaanottamisesta. Jos puutteista ei ole ilmoitettu kymmenen (10) päivän kuluessa, lähetyksen katsotaan virheettömäksi. Korvausvaatimusten esittäminen asiakkaan osoittamista piilevistä puutteista on mahdollista vain takuuajana. Jos GT MEDICARE toteaa valituksen aiheelliseksi, GT MEDICARE on velvollinen ainoastaan korjaamaan tai vaihtamaan vialliset tuotteet, eikä asiakkaalla ole oikeutta vaatia minkäänlaista muuta korvausta. Korvausvaatimuksen esittäminen ei vapauta asiakasta maksusta.

Tuotteen tiedot lyhyesti

Kiitos SixCase-kaapin hankinnasta.

Mitä SixCase sisältää?

SixCase sisältää seuraavat osat:

- SixCase AED -seinäkaappi
- Avain (valinnainen)
- 24 voltin sovitin (SC1320/1330/1340/1415/1420/1435)
- Syöttöjohto 3 m (SC1320/1330/1340/1415/1420/1435)
- Asennuskaavio
- Lämmitin (SC1320/1330/1340/1415/1420/1435)
- GSM-moduuli (SMS-tietopaketti)
- Orgaaninen tulppa (4x)
- Vaarna ruuvi (4 x)
- Aluslevy (4 x)
- Renkaat (4 x)
- Pultit (4 x)
- Lihavoidut numerot tarkoittavat määriä.

Asennus

Tärkeää

Toimitetut asennustyökalut on tarkoitettu vain laitteen asentamiseen tasaiselle puu-, tiili- tai betoniseinään. Seinäpaneelin vähimmäispaksuus on 3 mm. Käytä aina ylitarjontaa välilevyt.

Asentaminen tiili- tai betoniseinään

Aseta mukana toimitettu asennuskaavio seinää vasten ja merkitse reikien paikat. Poraa pyöreät 10 mm:n reiät vähintään 60 mm:n syvyyteen. Tämä varmistaa, että tulpaa varten tarvittava syvyys on riittävä. Suosittelemme, että ylemmät reiät porataan 1,5–1,6 metrin korkeudelle maasta. Reiät täytyy porata aina tiilen keskelle.



Syöttökaapeli

SixCase suosittelee, että 12 mm:n reikä porataan niin, että syöttökaapeli voidaan vetää seinän läpi. Kaapeli voidaan sitten kiinnittää 24 V:n sovittimeen, joka asetetaan rakennuksen sisäpuolelle. On tärkeää, että syöttökaapeli viedään seinän läpi, ennen kuin kaappi asennetaan seinään.

Kaapeli kiinnitetään siinä olevan liittimen avulla SixCase-kaappiin. Vie kaapeli ulkopuolelta seinän läpi sisäpuolelle. Vedä kaapelia sitten sisäpuolelta, kunnes liitin koskettaa seinää. Kaapeli voidaan viedä reiän kautta, minkä jälkeen SixCase on valmis asennettavaksi seinään. Kun kaappi on kiinnitetty paikalleen neljällä mutterilla, myös liitin voidaan kiinnittää muovimutterilla.

Ole varovainen

Jos seinä ei ole riittävän tukeva, suosittelemme Fischer VS 100P -laastin käyttämistä. Kun neste on ruiskutettu reikiin, kiinnitit vain kaksi ruuvia – älä käytä enää tulppia. Lue Fischerin tuoteselosteen ohjeet huolellisesti. Varmista, että olet puhdistanut reiät perusteellisesti poraamisen jälkeen.

Asentaminen puuseinän

Poraa puuhun pienet, läpimitaltaan noin 4 mm:n reiät ja kiristä ripustusruuvit tiukasti puuhun käyttäen apuna työkalua. Asenna SixCase-kaappi edellä olevien ohjeiden mukaan. Ruuvit saavat jäädä näkyviin enintään 30 mm puun pinnasta. Kiinnitit SixCase-kaappi paikalleen neljällä ruuvilla. Suosittelemme, että ylemmät reiät porataan 1,5–1,6 metrin korkeudelle maasta.

SixCase-kaapin kiinnittäminen

Ripusta SixCase-kaappi seinään kiinnittämiesi ripustusruuvien varaan. Voit kiristää mutterit käyttämällä kiintoavainta, jonka koko on 13. Varo, ettei syöttökaapeli jää jumiin.

Käyttö

Sulje kaappi asettamalla kädet alas kaapin vasemmalle ja oikealle puolelle ja työntämällä ylöspäin. Kun molemmat lukot (vasen ja oikea) napsahtavat kuuluvasti, kaappi on lukittu oikein kummaltakin puolelta.

Hätätilanteet (AED:n käyttö)

SC1310: Paina punaista painonappia (katso ohjetarra), odota, että kannatin on alimmassa asennossa, ja poista AED.

SC1415: Aseta avain kannattimen alle oikealle puolelle (katso ohjetarra) ja käännä avainta voimakkaasti oikealle. Odota, että kannatin on alimmassa asennossa, ja poista AED.

SC1420: Paina punaista painonappia (katso ohjetarra), odota, että kannatin on alimmassa asennossa, ja poista AED.

SC1320/1340/1435: Näppäile ohjelmoitu koodi tai aseta avain oikealle ja käännä sitä voimakkaasti oikealle (katso ohjetarra), odota, että kannatin on alimmassa asennossa, ja poista AED (sekä koodin että avaimen on oltava käytettävissä hätätilanteissa).

Tärkeää

Avauskoodin, avaimen ja SMS-koodin on ehdottomasti oltava käytettävissä hätätilanteissa (koskee malleja SC1435). Yllättävän vian vuoksi jokin avausmenetelmä ei ehkä toimi. Tällaisessa tapauksessa käytettävissä täytyy olla vaihtoehtoinen menetelmä. On myös tärkeää harjoitella edellä kuvattuja avausmenetelmiä ennen AED:n asettamista kaappiin ja usein sen asentamisen jälkeen.

Huolto ja vianetsintä

Huolto

On erittäin tärkeää avata ja sulkea SixCase-seinäkaappi viikoittain ja tarkastaa, että lukitusjärjestelmät



ja kaikki elektroniset osat toimivat oikein. Tarkastuksen yhteydessä on varmistettava, että painonappi, koodinäppäimistö, avainlukko ja jousilukko toimivat oikein. Jos mahdollista, myös defibrillaattorin tila täytyy tarkastaa (katso AED:n käyttöopas). Kun punaista painonappia on painettu voimakkaasti, avain on asetettu lukkoon tai koodi on näppäilty, kaapin alaosan pitäisi laskeutua esteettä alas, minkä jälkeen defibrillaattori voidaan ottaa esille. On myös tärkeää tarkastaa kaapin kunto ulkopuolelta sellaisten vaurioiden varalta, jotka saattavat vaikuttaa sen toimintaan. Jos kaapissa on sähköinen lukitusjärjestelmä, moottori tarkastetaan automaattisesti kerran päivässä. Jos havaitset vian, ota yhteys jälleenmyyjään tai suoraan SixCase-yhtiöön. Sen mukaan, millaisesta viasta on kyse, AED joudutaan ehkä poistamaan kaapista. Käyttäjille on tällöin ilmoitettava, että AED ei ole käytettävissä.

Lämpötila

Jos epäilet lämmittimen toimivuutta (ulkolämpötila on alle 0 °C (32 °F), poista defibrillaattori ja ota yhteys jälleenmyyjään tai suoraan SixCase-yhtiöön.

Malleissa SC1330/1340/1415/1420/1435 on aktiivinen tuuletusjärjestelmä. Tuuletin käynnistyy lämpötilan ollessa noin 30 °C ja imee alaosasta kylmää ilmaa, jolloin yläosa viilenee. Suosittelemme kuitenkin kaapin asentamista varjoon, jotta lämpötila ei nouse liian korkeaksi (yli 50 °C)

Koodin vaihtaminen

SixCase-kaapin oletuskoodi: 1234

Koodin vaihtaminen:

Avaa SixCase-kaappi avaimella tai käyttämällä oletuskoodia (1234).

Jos haluat vaihtaa koodin, näppäile koodi 1245. Hälytys päättyy.

Näppäile uusi koodi ja vahvista se painamalla vihreää V-painiketta. Hälytys käynnistyy uudelleen.

Koodi on nyt vaihdettu.

Huomautus: Varmista aina koodin vaihto avaamalla Six-Case AED -kaappi uudella koodilla.

Hätäpainikkeen lasin vaihtaminen

Jos hätäpainikkeen lasi täytyy vaihtaa, avaa kaappi ja poista defibrillaattori. Lukitusjärjestelmä on nyt selkeästi näkyvissä AED:n kannattimen nelionmuotoisen aukon läpi kaapin sisäpuolella. Punainen painonappi on lukittu lukitustapilla. Irrota se ja sen jälkeen painonappi ja poista lasi tai osa siitä.

Aseta uusi lasi punaisen painonapin ympärille. Kiinnitä painonappi takaisin ja lukitse se sokalla. Varmista ennen kaapin sulkemista, että lukitusjärjestelmä on liitetty oikein kumpaankin (vasempaan ja oikeaan) jousilukkoon. Testaa lukitusjärjestelmä, ennen kuin suljet kaapin.

Huomaa, että lukitusjärjestelmään on voinut jäädä lasinpaloja rikkoutuneesta turvalasista. Poista kaikki palat ennen uuden turvalasin asentamista.





Vianetsintä

Ongema	Ratkaisu
LED-valot eivät pala	Tarkasta ulkoinen virta (virtalähde ja sovitin). Tarkasta johdot mittaamalla jännite kaapin sisällä (12 tai 24 voltia). Jos ongelma jatkuu, poista laite käytöstä, irrota ohjauksyksikkö ja ota yhteys jälleenmyyjään tai SixCase-yhtiöön.
Pin code touch pad reageert niet op input	Controleer of de externe voeding goed is aangesloten (voedingskabel en adapter) Meet in de kast of er stroom aanwezig is (12 of 24 Volt) Indien de fout niet opgelost kan worden adviseren wij de kast en eventueel AED buiten dienst te stellen en contact op te nemen met uw dealer of SixCase.
Kaappi ei sulkeudu oikein	Avaa kaappi manuaalisesti tai koodilla/tekstiviestillä. Aseta kädet alas kaapin vasemmalle ja oikealle puolelle ja työnnä ylöspäin. Kun molemmat lukot (vasen ja oikea) napsahtavat kuuluvasti, kaappi on lukittu oikein kummaltakin puolelta. Jos ongelma jatkuu, poista laite käytöstä ja ota yhteys jälleenmyyjään tai Six-Case-yhtiöön.
Kaappi ei avaudu samalla tavalla molemmilta puolilta (SC1310/1330/1420)	Sulje kaappi uudelleen. Paina punaista painonappia voimakkaammin. Jos ongelma jatkuu, poista laite käytöstä ja ota yhteys jälleenmyyjään tai Six-Case-yhtiöön.
PIN-koodinäppäimistö reagoi, mutta kaappi ei avaudu samalla tavalla molemmilta puolilta (SC1320/1340/1435)	Vedä alakannatinta kohtalaisen voimakkaasti; jos kaappi avautuu, kokeile normaalia menettelyä uudelleen. Jos kaappi ei avaudu, lukitusjärjestelmässä on vika tai jokin osa puuttuu; poista laite käytöstä ja yhteys jälleenmyyjään tai SixCase-yhtiöön.
Punainen painonappi toimii, mutta kaappi ei avaudu (SC1310/1330/SC1420)	Vedä alakannatinta kohtalaisen voimakkaasti; jos kaappi avautuu, kokeile normaalia menettelyä uudelleen. Jos kaappi ei avaudu, lukitusjärjestelmässä on vika tai jokin osa puuttuu; poista laite käytöstä ja yhteys jälleenmyyjään tai SixCase-yhtiöön.



Sanasto

AED

AED eli puoliautomaattinen defibrillaattori on tärkeä apuväline sydämenpysähdyksen ensihoidossa. On erittäin tärkeää, että AED-defibrillaattori on hyvin suojattu ja heti saatavilla hätätilanteessa joka päivä kaikkina vuorokaudenaikoina.

Käyttäjä

Henkilö, joka on vastuussa kaapista ja AED-defibrillaattorista. Hänen velvollisuutensa on tarkastaa AED:n ja kaapin tila ja varmistaa niiden toimivuus tässä oppaassa kuvattujen ohjeiden mukaisesti.

GSM

Lyhenne sanoista Global System for Mobile Communications (matkapuhelimille parhaiten sopiva matkapuhelinverkko-standardi).

SMS

Lyhenne sanoista Short Message Service (tietoliikenneprotokolla, jota käyttämällä voidaan lähettää ja vastaanottaa tekstiviestejä matkapuhelimien välillä).

Online-palvelu

Lisätietoja ja online-ohjeita on verkkosivuillamme osoitteessa www.sixcase.com.

Käyttöopas: Käyttöopas sisältää kaikki tiedot SixCase-kaapin käyttämiseen. Päivityksiä julkaistaan verkkosivuillamme.



Vastuuvapauslauseke: GT Medicare ei ole millään tavalla vastuussa SixCase-kaapissa säilytettävän AED-defibrillaattorin saatavuudesta tai toimivuudesta. GT Medicare ei ole vastuussa tämän asiakirjan sisältämistä asennus-, käyttö- tai toimintatiedoista eikä tietojen tai ansioiden menetyksestä tai kolmansille osapuolille suoraan tai epäsuorasti aiheutuneista vahingoista. Poikkeukselliset ulkoiset olosuhteet, kuten alhainen lämpötila, vialliset osat tai muut ulkoiset seikat voivat aiheuttaa sen, että AED-defibrillaattoreita ei voi käyttää.

SixCase pidättää oikeuden muokata ja parantaa tätä asiakirjaa ja kaikkia tässä käyttöoppaassa mainittuja tuotteita ilman ennalta annettua ilmoitusta. Tämän asiakirjan sisällöstä ei anneta minkäänlaisia takuita.

Yhteystiedot

GT Medicare BV

Bargelaan 6

2333 CT Leiden

Alankomaat

Puhelin: +031 (0) 71 2100 229

Sähköposti: info@sixcase.com



Innehållsförteckning

Vad är SixCase?	16
Allmän beskrivning	16
För din säkerhet	16
Konventioner	16
Störningar	17
Viktigt!	17
Garanti	17
Produktöversikt	18
Vad finns med i förpackningen?	18
Installation	18
Viktigt	18
Montering i sten eller betong	18
Nätkabel	18
Obs	19
Montering i trä	19
Häng upp SixCase	19
Användning	19
I en nödsituation (användning av AED)	19
Viktigt	19
Underhåll och felsökning	19
Underhåll	19
Temperatur	20
Ändra och använd pinkoden	20
Byta ut glaset	20
Felsökning:	21
Ordlista	22

Vad är SixCase?

En AED (Automatisk Extern Defibrillator) utgör nuförtiden en viktig del av primärvården. Därför är det livsviktigt att er AED är väl skyddad, men ändå tillgänglig dygnet runt. SixCase ger ett optimalt skydd, säkerhet och ser till att er AED kan användas både dag och natt. Den unika SMS-modulen använder sig av moderna kommunikationsmedel (GSM, SMS) för att styra SixCase. Skåpets unika formgivning utgör ett bra skydd åt er AED och det är vattentätt. För att kunna tåla extrema väderförhållanden har SixCase en temperatursensor för att kunna skapa en optimal temperatur för er AED.

Allmän beskrivning



En Se sidan 1 och 2.

1. Kontrollenhet (med LED-lampor, summer och fläkt. Pekplatta för pinkod endast för SC1435, SC1320, SC1340))
2. Säkerhetsinstruktioner
3. Röd tryckknapp
4. Snäpplåssystem (höger)
5. AED-hållare (med värmare SC1330, SC1340, SC1415, SC1420, SC1435)
6. Låstapp
7. LED-lampor
8. Nätkabel

För din säkerhet

Konventioner

Läs igenom dessa instruktioner noga. Det kan vara farligt eller till och med olagligt att inte följa instruktionerna. Läs igenom hela bruksanvisningen för mer information.

		Symbol
Varning:	Varningsmeddelanden varnar för tillstånd eller åtgärder som kan medföra personskada eller dödsfall.	
Försiktighet:	Försiktighetsmeddelanden varnar för tillstånd eller åtgärder som kan medföra skada på enheten.	

Störningar

Alla trådlösa apparater kan vara känsliga för störningar. Detta kan påverka apparaten på ett negativt sätt.

Viktigt!

SixCase är inte ansvarigt för innehållet i detta dokument och inte heller för förlorade uppgifter, inkomster, direkta eller indirekta skador, oberoende av hur dessa har förorsakats. SixCase förbehåller sig rätten att anpassa eller förbättra dokument som gäller för alla produkter som publiceras i denna bruksanvisning, utan att detta meddelas i förväg. Innehållet i detta dokument tillhandahålls utan någon som helst form av garanti. Detsamma gäller för tillbehör till produkten.

Garanti

- GT MEDICARE är efter bästa förmåga ansvarigt för kvaliteten på tjänsterna och för skicket och kvaliteten på levererade produkter, med förbehållet att garantin faller inom följande nämnda villkor.
- Om en defekt orsakas av köparen kommer kostnader för reparation och frakt att tillfalla köparen.
- Köparen har ingen rätt till garanti:
 - Om köparen har misskött produkterna.
 - Om köparen har ändrat produkterna eller utfört

reparationer som inte utförts av GT MEDICARE eller ett ombud för GT MEDICARE.

C: Vid felaktig eller vårdslös användning, felaktig anslutning, fel spänning, blixtnedslag, skada orsakad av fukt eller andra externa produkter eller missöden.

D: Om anordningen inte befinner sig i det vanliga eller användarreda skick som beskrivs för att kunna underhållas.

E: Om anordningen används tillsammans med undermåliga eller fel tillbehör.

F: Om köparen hanterat produkterna på ett ovarsamt sätt.

- GT MEDICARE garanterar att produkterna inte innehåller allvarliga defekter vid tidpunkten för leverans.
- Återförsäljare ska skriftligen rapportera defekter, skador och bristande överensstämmelse hos produkterna, som rimligen kan fastställas vid inspektion, till GT MEDICARE inom 10 dagar efter mottagande. Återförsäljaren ska skriftligen rapportera alla andra defekter till GT MEDICARE inom ett år efter leveransdatum. Produkter som uppvisar bristande överensstämmelse eller skador ska omedelbart returneras till GT MEDICARE för inspektion av GT MEDICARE. Anspråk som inte rapporteras enligt villkoren i denna paragraf kommer inte att accepteras. GT MEDICARE kommer, i händelse av ansvar för bristande överensstämmelse hos eller skada på produkten, efter eget val att reparera produkten, ersätta den med en ny eller återbetala produktens inköpspris. GT MEDICARE har inga andra förpliktelser eller skadeståndsskyldigheter gentemot återförsäljaren med avseende på produkter med bristande överensstämmelse eller skador utöver de som nämns i den förra meningen.
- Garantin gäller under 60 månader från leveransda-



tum för väggskåp, där repor och skador på skåpet och fönstret faller utanför garantin. Garantin för elektroniken gäller under 24 månader från leveransdatum. Tillverkaren är endast skyldig att uppfylla de krav som härrör från denna garanti. Tillverkaren är inte ansvarig för indirekta skador eller följdskador. I samtliga fall är tillverkarens skadeståndsskyldighet begränsad till försäljningspriset för produkterna som sålts.

7. När ett anspråk kan tillskrivas en ändring eller felaktig användning av produkten som beskrivs i kontraktet förfaller under alla omständigheter garantin.
8. Mottagaren ska undersöka den mottagna utrustningen omedelbart. Kunden måste skriftligen informera GT MEDICARE inom tio (10) dagar efter mottagandet om eventuella defekter i försändelsen. Om defekterna inte rapporteras inom tio (10) dagar kommer försändelsen att anses vara komplett. Anspråk som gäller gömda defekter, som måste bevisas av kunden, är bara möjliga inom garantitiden. Om ett klagomål godkänns av GT MEDICARE är GT MEDICARE bara förpliktigt till att ersätta eller reparera den defekta artikeln, utan att kunden är berättigad till att göra anspråk på någon kompensation över huvudtaget. Inlämning av en fordran befriar inte kunden från betalningsskyldighet.

Produktöversikt

Tack så mycket för att ni köpt ett SixCase AED väggskåp.

Vad finns med i förpackningen?

SixCase innehåller följande delar:

- SixCase AED väggskåp
- Nyckel (Tillval)
- 24V Adapter (SC1320/ 1330/ 1340/ 1415/ 1420/

1435)

- Nätkabel 3m (SC1320/ 1330/ 1340/ 1415/ 1420/ 1435)
- Fästmall
- Uppvärmning (SC1320/ 1330/ 1340/ 1415/ 1420/ 1435)
- GSM Modul (SMS info pack)
- Pluggar (4x)
- Dympling skruv (4x)
- Distanshylsor (4x)
- Ändringar (4x)
- Muttrar (4x)

Installation

Viktigt

Det är oerhört viktigt att monteringen görs korrekt, och detta faller inte under SixCases ansvar. Det bifogade upphängningsmaterialet är endast avsett för montering på plana väggdelar i massivt trä, sten, betong eller metallplåtar med en minimal tjocklek på 3 mm. Vi avråder er från att hänga upp SixCase på lättare metaller, som till exempel aluminium. Använd alltid de medföljande distanserna.

Montering i sten eller betong

Håll upp den bifogade mallen (A4-format) mot väggen och rita av hålen. Borra hålen på $\varnothing 10$ mm med ett minimalt djup på 6 cm (60 mm), så att du får en tillräcklig inbyggnadslängd för pluggen eller för fästbruket. Rekommenderad höjd för de översta hålen är cirka 1,5 m. Hålen måste alltid borraras i mitten av stenen.

Nätkabel

SixCase rekommenderar att även borra upp det mittersta hålet ($\varnothing 12$ mm), så att nätkabeln kan löpa genom väggen. Standard följer en adapter och en nätkabel på 3 meter med. Denna nätkabel kan fästas i adaptern med hjälp av ett anslutningsdon. Anslutningsdonet kan föras igenom



ett hål på $\varnothing 12$ mm. Det är viktigt att adaptern placeras inomhus. Innan SixCase hängs upp är det viktigt att föra nätkabeln genom väggen. Kabeln har en klämbussning, med vilken kabeln kan fästas på SixCase. För kabeln utifrån genom/över väggen och in, tills klämbussningen ligger mot väggen. Därefter kan SixCase hängas upp på väggen och kabeln kan föras genom det mittersta hålet. Vrid fast plastmuttern inifrån och klicka fast anslutningsdonet upp till på modulplåten. Nu är SixCase ansluten.

Obs

Om väggen är för svag för att klara att SixCase hängs upp ordentligt med pluggar så rekommenderar vi Fischer VS 100 P. Med dessa räcker det att vrida in skruven (utan plugg) i murbruket. På förpackningen till Fischer VS 100 P finns en bruksanvisning. Rengör först hålen ordentligt (1x blås ut, 1x borsta rent, 1x blås ut, 1x borsta rent) innan du för in pluggen eller fästbruket i borrhålet.

Montering i trä

Använd den bifogade mallen och borra små hål på $\varnothing 4$ mm i träet och skruva sedan in de gängade skruvarna i träet, låt M8-änden sticka ut maximalt 30 mm. Rekommenderad höjd för de översta hålen är cirka 1,5 m. I änden av den gängade M8-stången går det att placera en nyckel så att skruven kan skruvas in i träet med rätt moment.

Häng upp SixCase

Häng upp skåpet på de gängade stänger som just har fästs i väggen eller i träet. Fäst SixCase genom att på insidan skruva fast de bifogade M8-muttrarna med ändringar, dra åt handfast med nyckel 13. Obs! Se till att inte adapterkabeln kläms fast!

Användning

Placera båda händerna på skåpets nedre högra och vänstra sida och tryck uppåt för att stänga skåpet. Båda låsen (vänster och höger) kommer då att avge ett hörbart klick som bekräftar att

skåpet är ordentligt låst på båda sidor.



En nödsituation (användning av AED)

SC1310: Tryck på den röda knappen (enligt instruktionsmärket), vänta tills hållaren har nått sitt lägsta läge och ta ut AED.

SC1415: Sätt in nyckeln på höger sida under hållaren (enligt instruktionsmärket) och vrid med kraft nyckeln åt höger. Vänta tills hållaren har nått sitt lägsta läge och ta ut AED. SC1420: Tryck på den röda knappen (enligt instruktionsmärket), vänta tills hållaren har nått sitt lägsta läge och ta ut AED.

SC1320/ 1340/ 1435: För in den programmerade koden eller sätt in nyckeln på höger sida och vrid nyckeln med kraft åt höger (enligt instruktionsmärket). Vänta tills hållaren har nått sitt lägsta läge och ta ut AED (både kod och nyckel måste finnas tillgängliga i händelse av en nödsituation).



Viktigt

Det är obligatoriskt att alltid ha koden, nyckeln och SMS-koden tillgängliga i händelse av en nödsituation (gäller SC1435). En oväntad defekt kan göra att en av öppningsprocedurerna misslyckas. I så fall är det nödvändigt att ett alternativ finns tillgängligt. Dessutom är det viktigt att öva på de ovan nämnda procedurerna innan defibrillatorn läggs i förvaring och ofta efter att AED har installerats.

Underhåll och felsökning



Underhåll

Det är avgörande att öppna och stänga Six-Case-väggskåpet varje vecka för att kontrollera att låssystemen och alla elektroniska delar fungerar korrekt. Vid denna kontroll bör du noga observera om tryckknappen, kodknappsatsen, nyckellåset och snäpplåset fungerar korrekt och om möjligt defibrillatorns status (se bruksanvisningen till AED). När man med kraft tryckt in den röda knappen, fört in nyckeln eller angett koden ska skåpets



nedre del gradvis röra sig nedåt utan att stöta på hinder, och därmed ge tillgång till defibrillatorn.

Det är också viktigt att kontrollera skåpets yttre skick så att inga skador uppstått som möjligen kan påverka dess funktion. Om skåpet har ett elektriskt låssystem kommer motorn att automatiskt kontrolleras en gång per dag. Om en defekt upptäcks ska återförsäljaren eller SixCase kontaktas direkt. Beroende på typen av defekt kan det vara tillrådligt att ta bort AED och informera användarna om dess status (otjänlig).

Temperatur

Om du har något tvivel kring huruvida uppvärmningen fungerar korrekt (yttertemperatur lägre än 0 °C), avlägsna då defibrillatorn och kontakta återförsäljaren eller SixCase direkt. SC1330/ 1340/ 1415/ 1420/ 1435 är utrustade med ett aktivt ventilationssystem. Vid cirka 30 °C kommer fläkten att starta för att frigöra värme från den övre delen och dra in kall luft från den nedre delen. Trots det rekommenderar vi att skåpet installeras i skugga för att förekomma höga temperaturer (över 50 °C).

Ändra och använd pinkoden

Standard är pinkoden för att öppna SixCase inställd på: 1234

Ändra pinkoden: Öppna SixCase väggskåp med nyckeln eller med den pinkod som redan ställts in (1234).

Knappa in koden 1245 för att kunna ändra pinkoden, larmet stoppas. För in den nya pinkoden och bekräfta den med det gröna V, nu hörs larmet igen. Koden har ändrats.

Tips!


Kontrollera alltid den ändrade pinkoden genom att öppna SixCase AED-väggskåp med den nya pinkoden.

Byta ut glaset

Öppna skåpet och ta ut defibrillatorn när glaset ska bytas ut. Nu kan man tydligt se låssystemet genom det fyrkantiga hålet i AED-hållaren på insidan av skåpet. Den röda knappen är låst av en låstapp som kan avlägsnas. Man kan därefter ta ut knappen och avlägsna glaspanelen eller delar av den.

Det nya glaset kan nu placeras runt den röda knappen och knappen återinstalleras och låsas med låstappen. Kontrollera innan skåpet stängs att låssystemet är korrekt anslutet till båda (vänster och höger) snäpplås. Testa låssystemet innan skåpet stängs.

Var medveten om att låssystemet kan innehålla kvarvarande glaspartiklar från det krossade glaset. Avlägsna alla partiklar innan det nya glaset installeras.

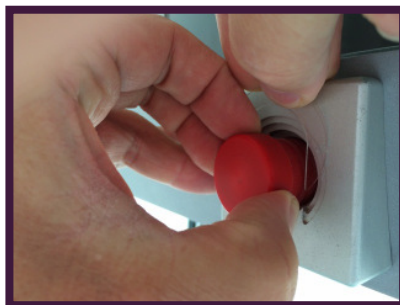



Felsökning:

Symtom	Åtgärd
LED-lamporna lyser inte	Kontrollera extern ström (strömförsörjning och adapter) Kontrollera kablar genom att mäta strömmen inne i skåpet (12 eller 24 volt) Om enheten fortfarande inte fungerar ska den tas ur bruk, kontrollenheten avlägsnas och återförsäljaren eller SixCase kontaktas.
Pekplattan för pinkoden reagerar inte på inmatning	Kontrollera extern ström (strömförsörjning och adapter) Kontrollera kablar genom att mäta strömmen inne i skåpet (12 eller 24 volt) Om enheten fortfarande inte fungerar ska den tas ur bruk, kontrollenheten avlägsnas och återförsäljaren eller SixCase kontaktas.
Skåpet stängs inte korrekt	Öppna skåpet manuellt eller via kod/SMS Placera båda händerna nertill på skåpets vänstra och högra sida och tryck uppåt. Båda låsen (vänster och höger) måste avge ett hörbart klick som bekräftelse på att skåpet är ordentligt låst på båda sidor. Om enheten fortfarande inte fungerar ska den tas ur bruk och återförsäljaren eller SixCase kontaktas.
Skåpet öppnas inte lika mycket på båda sidor (SC1310/1330/ 1420)	Stäng skåpet igen. Använd mer kraft för att trycka in den röda knappen. Om enheten fortfarande inte fungerar ska den tas ur bruk och återförsäljaren eller SixCase kontaktas.
Pekplattan för pinkoden reagerar men skåpet öppnas inte lika mycket på båda sidor (SC1320/ 1340/ 1435)	Tillämpa måttlig kraft på den nedre hållaren och om skåpet öppnas prova normal procedur igen. Om skåpet inte öppnas är låssystemet defekt eller en del saknas. Ta skåpet ur bruk och kontakta återförsäljaren eller SixCase.
Röda knappen verkar fungera men skåpet öppnas inte (SC1310/1330/ SC1420)	Tillämpa måttlig kraft på den nedre hållaren och om skåpet öppnas prova normal procedur igen. Om skåpet inte öppnas är låssystemet defekt eller en del saknas. Ta skåpet ur bruk och kontakta återförsäljaren eller SixCase.



Ordlista

AED

AED (Automatic External Defibrillator), även kallad hjärtstartare, är ett bärbart redskap som används på personer som drabbats av hjärtstillestånd. Genom att avge en elektrisk chock försöker man få hjärtat att återgå till en normal rytm igen.

Operator/ user

Person som får ett sms-meddelande, när SixCase öppnas.

GSM

Global System for Mobile communications: avlett från Groupe Special Mobile, den vanligaste standarden för mobiltelefoner i världen.

SMS

Short Message Service (SMS) är ett kommunikationsprotokoll som gör det möjligt att skicka textmeddelanden mellan mobiltelefoner.

Vård online

Mer information eller online service hittar du på vår hemsida www.sixcase.com.

Bruksanvisning

Bruksanvisningen innehåller all nödvändig information för hantering av SixCase. Uppdateringar publiceras på vår webbplats.



Ansvarighet

GT Medicare är på inget sätt ansvarigt för tillgängligheten eller servicebarheten hos AED som förvaras i SixCase-skåpet. GT Medicare är varken ansvarigt för detta dokumentets innehåll om installation, användning eller drift eller för förlust av data, inkomst, direkt eller indirekt orsakad skada på tredje part. Exceptionella externa förhållanden, som t.ex. låga temperaturer, defekta delar eller andra externa element kan resultera i en otjänlig AED. SixCase förbehåller sig rätten att anpassa och förbättra detta dokument och alla relaterade produkter i denna bruksanvisning utan föregående meddelande. Innehållet i detta dokument tillhandahålls utan någon som helst form av garanti.

Kontakt

GT Medicare BV
Bargelaan 6
2333 CT Leiden
Nederländerna
T +031 (0) 71 2100 229
E info@sixcase.com



Inhaltsverzeichnis

Was ist SixCase?	23
Allgemeine Beschreibung	23
Für Ihre Sicherheit	23
Warnung	23
Störung	24
Zubehör	24
Wichtig	24
Garantie	24
Introduktion SixCase	25
Inhalt des Paketes	25
Montageanleitung	25
Wichtig	25
Montage auf Stein oder Beton	26
Stromkabel	26
Bitte beachten	26
Montage auf Holz	26
Ufhängen SixCase	26
Betrieb	26
Im Notfall (Gebrauch des AED)	26
Wichtig	27
Wartung und Problemlösung	27
Wartung	27
Wichtig	27
Temperatur	27
CODE ändern	27
Austausch des Sicherheitsglases	27
Problemlösung	28
Glossary	29

Was ist SixCase?

Der AED (Automatischer Externer Defibrillator) macht inzwischen einen wichtigen Teil der primären Hilfe aus. Es ist dabei lebenswichtig, das der AED Tag und Nacht gut gesichert, aber doch erreichbar ist. Der SixCase gibt eine optimale Beschirmung/Sicherheit und sorgt für ein Tag und Nacht einsetzbaren AED. Das besondere SMS Modul macht Gebrauch von den modernsten Kommunikationsmethoden (GSM, SMS) um den SixCase anzusteuern.

Allgemeine Beschreibung

Siehe Seite 1 und 2.

1. Steuerung (mit LED-Anzeige, Buzzer und Ventilator. Pin-Touchpad nur für SC1435, SC1320, SC1340)
2. Sicherheitshinweise
3. Roter Druckknopf
4. Rotor-Verschlussystem (rechts)
5. AED-Halterung (mit Heizapparat SC1330, SC1340, SC1415, SC1420, SC1435)
6. Schlossstift
7. LED
8. Stromkabel



Für Ihre Sicherheit

Warnung

Lesen Sie das Instruktionsbuch sorgfältig durch. Alle Benutzer sollten vor dem ersten Gebrauch des SixCase AED Cabinet die Sicherheitshinweise lesen. Das nicht befolgen der Instruktionen kann gefährlich sein, oder selbst gegen Gesetze verstoßen. Befolgen Sie alle empfohlenen Wartungsanweisungen. Sollte ein Problem auftreten, wenden Sie sich unverzüglich an den Wartungsservice. Benutzen Sie das Gerät nicht, bevor es von einem qualifizierten



Mitarbeiter überprüft wurde.

		Symbol
Warnung	Warnhinweise machen Sie auf Situationen oder Handlungen aufmerksam, die zu Personenschäden oder zum Tod führen können.	
Achtung:	Hinweise machen Sie auf Situationen oder Handlungen aufmerksam, die das Gerät beschädigen können.	

Störung

Alle drahtlosen Apparaturen können anfällig sein für Störungen. Dadurch kann die Wirkung des Apparates negativ beeinflusst werden.

Zubehör

Verwenden Sie nur durch uns akzeptiertes Zubehör, schließen Sie keine nicht kompatiblen Produkte an.

Wichtig

SixCase ist nicht verantwortlich für den Inhalt von Dokumenten, noch für den Verlust von Informationen, Einkommen, direktem oder indirektem Schaden, durch wie dann auch verursacht. SixCase behält sich das Recht vor um Dokumente anzupassen oder zu verbessern, ohne vorherige Bekanntmachung. Dieses gilt für alle Produkte beschrieben in dieser Gebrauchsanweisung. Der Inhalt dieses Dokumentes sowie auch für das Zubehör zu diesem Produkt wird ohne Garantie veröffentlicht.

Garantie

- GT MEDICARE ist nach bestem Wissen und Gewissen verantwortlich für die Servicequalität und die Zuverlässigkeit und gute Qualität der gelieferten Produkte, mit der Maßgabe, dass die Garantie nicht über die folgenden Garantiebestimmungen hinausgeht.
- Wenn der Defekt vom Käufer verursacht wurde, gehen die Reparatur- und Versandkosten zu seinen Lasten.
- Der Käufer hat keinen Garantieanspruch:
 - A: bei fahrlässigem Umgang mit den Produkten.
 - B: bei vom Käufer vorgenommenen Änderungen oder Reparaturen an den Produkten, die nicht von GT MEDICARE oder in deren Namen durchgeführt wurden.
 - C: bei unangemessenem und unsorgfältigem Gebrauch, falschem Anschluss, falscher Spannung, Blitzeinschlag, Schäden infolge eindringender Feuchtigkeit oder anderen externen Produkten oder Unfällen.
 - D: bei unangemessener Wartung der Geräte.
 - E: bei Verwendung von minderwertigem oder falschem Zubehör.
 - F: bei nachlässigem Umgang mit den Geräten.
- GT MEDICARE garantiert, dass die Produkte bei der Lieferung keine ernsthaften Beschädigungen aufweisen.
- Händler werden Defekte, Schäden oder Nichtkonformität der Produkte, die bei einer Eingangskontrolle festgestellt werden, innerhalb von zehn (10) Tagen nach der Lieferung schriftlich an GT MEDICARE melden. Händler werden alle anderen Defekte innerhalb eines (1) Jahres nach dem Lieferdatum schriftlich an GT MEDICARE melden. Produkte, die einen vermutlichen Defekt oder



Nichtkonformität aufweisen, sollten sofort an GT MEDICARE zur Inspektion zurückgesandt werden. Reklamationen, die nicht anhand der vorstehenden Bestimmungen eingereicht wurden, werden nicht akzeptiert. GT MEDICARE wird bei einem Defekt oder einer Nichtkonformität, für die GT MEDICARE verantwortlich ist, das/die betreffende/n Produkt/e nach eigenem Ermessen reparieren oder ersetzen oder den Kaufpreis der Produkte zurückerstatten. GT MEDICARE hat keine anderen (Haftungs-) Verpflichtungen gegenüber dem Händler in Bezug auf nicht konforme oder defekte Produkte als die im vorstehenden Satz beschriebenen.

6. Die Garantiedauer ab Lieferung auf alle mechanischen Teile beträgt sechzig (60) Monate für den SC1400 und vierundzwanzig (24) Monate für den SC1300, wobei Kratzer und Beschädigungen des Gehäuses und Sichtfensters nicht unter diese Garantie fallen, und vierundzwanzig (24) Monate auf die Elektronik. Der Hersteller ist ausschließlich zur Erfüllung der sich aus dieser Garantie ergebenden Verpflichtungen verpflichtet. Der Hersteller haftet nicht für mittelbare Schäden oder Folgeschäden. In allen Fällen ist die Haftung des Herstellers auf den Verkaufspreis der verkauften Produkte beschränkt.
7. Wenn eine Forderung auf eine Änderung oder einen unsachgemäßen Gebrauch des Produkts, wie im Vertrag beschrieben, zurückzuführen ist, kann unter keinen Umständen Anspruch auf die Garantie erhoben werden.
8. Der Empfänger wird alle gelieferten Geräte unverzüglich kontrollieren. Der Kunde muss GT MEDICARE schriftlich innerhalb von zehn (10) Tagen nach Lieferung über Mängel in der Warensendung in Kenntnis setzen. Wenn die Mängel nicht innerhalb von zehn (10) Tagen gemeldet werden, wird die Warensendung als ordnungsgemäß erhalten be-

trachtet. Bei unsichtbaren Mängeln – vom Kunden nachzuweisen – können Garantieansprüche nur innerhalb der Garantiedauer geltend gemacht werden. Wenn eine Reklamation von GT MEDICARE akzeptiert wird, ist GT MEDICARE ausschließlich verpflichtet, die bemängelten Produkte zu reparieren oder zu ersetzen, ohne dass der Kunden irgendeinen Anspruch auf Schadensersatz hat. Reklamationen befreien den Kunden nicht von seinen Zahlungsverpflichtungen.

Introduktion SixCase

Inhalt des Paketes

Der SixCase enthält die folgenden Unterteile

- SixCase AED Wandgehäuse
- Schlüssel (optional)
- 24V Adapter (SC1320/ 1330/ 1340/ 1415/ 1420/ 1435)
- Stromkabel 3m (SC1320/ 1330/ 1340/ 1415/ 1420/ 1435)
- Montageanleitung
- Heizung (SC1320/ 1330/ 1340/ 1415/ 1420/ 1435)
- GSM Modul (SMS info pack)
- Wanddübel (4x)
- Stockschraube (4x)
- Abstandshalter (4x)
- Unterlegscheiben (4x)
- Muttern (4x)

Montageanleitung

Wichtig

Die korrekte Ausführung der Installation ist extrem wichtig und fällt außerhalb der Verantwortlichkeit von SixCase. Das mitgelieferte Material ist nur gedacht für Montagen an flache massivem Holz, Stein, Beton oder an metallenen Platten mit einer minimalen Stärke von 3mm. Verwenden



Sie immer die mitgelieferten Abstandshalter.

Montage auf Stein oder Beton

Positionieren Sie die beige-lieferte Schablone (A4 Format) auf die Mauer und zeichnen Sie die Bohrungen ab. Bohren Sie Löcher mit einem Durchmesser von 10mm und einer minimalen Tiefe von 6cm (60mm) um genug Raum zu haben für die Wanddübel oder evtl. chemischen Mörtel. Wir empfehlen die obersten Bohrungen ungefähr in 1,5m Höhe zu platzieren. Die Bohrungen müssen immer in der Mitte des Steines ausgeführt werden.

Montage Tipp SC1400 serie: mit einem Inbusschlüssel kann der Gewindestift mit der richtigen Vorspannung in die Mauer geschraubt werden. Der Stift muss bis zum metrischen Gewinde M8 eingeschraubt werden.

Stromkabel

SixCase advisiert die mittlere Bohrung mit einem 12mm Bohrer auszuführen, damit das Stromkabel ohne Probleme durch die Mauer geführt werden kann. Standard wird ein Adapter und 3m Kabel geliefert. Das Stromkabel kann mittels einer Steckverbindung an den Adapter angeschlossen werden. Diese Steckverbindung kann durch die 12mm Bohrung geführt werden, da der Adapter innerhalb von Gebäuden platziert werden muss.

Bevor der SixCase befestigt wird ist darauf zu achten, das Stromkabel durch die Mauer zu führen. Das Kabel ist mit einem Klemmfutter versehen, womit Sie es am SixCase fixieren können. Führen Sie das Kabel von außen durch/über die Mauer. Danach kann der SixCase aufgehängt, und das Stromkabel durch das mittlere Loch geführt werden.

Bitte beachten

Wenn sich herausstellt das die Mauer zu schwach ist um den SixCase mit Dübeln zu befestigen, empfehlen wir Fischer VS 100 P. Es ist dann ausreichend um nur die Stockschrauben ohne Dübel in den Mörtel zu schrauben. Auf der Verpackung von Fischer VS 100 P steht die korrekte Gebrauchsanweisung. Beachten Sie, das die Bohrungen

gut gereinigt werden (1x ausblasen, 1x ausbürsten, 1x ausblasen, 1x ausbürsten) bevor Sie den Dübel oder den chemischen Mörtel in die Bohrung stopfen.

Montage auf Holz

Bohren Sie an Hand der mitgelieferten Schablone kleine Löcher von 4mm Durchmesser in das Holz. Schrauben Sie die Stockschrauben so weit in das Holz, bis das M8 Stockschrauben noch maximal 30mm herausragt. Wir empfehlen die obersten Bohrungen ungefähr in 1,5m und 1,6m Höhe zu platzieren. Auf dem Ende der Stockschrauben kann ein Inbusschlüssel aufgesetzt werden, um die Schraube mit der richtigen Vorspannung in das Holz zu drehen.

Aufhängen SixCase

Hängen Sie das Gehäuse an die Stockschrauben, welche sie im Holz oder in der Mauer verankert haben. Befestigen Sie von der Innenseite aus den SixCase mittels der mitgelieferten M8 Muttern und den Unterlegscheiben. Drehen Sie mit einem Schraubenschlüssel 13 die Muttern fest an (nicht überdrehen). Beachten! Sorgen Sie dafür, dass das Adapterkabel nicht eingeklemmt wird.

Betrieb

Um das Gehäuse zu schließen, legen Sie die Hände rechts und links unten an das Gehäuse und drücken Sie nach oben. Beide Schlösser (links und rechts) werden mit einem hörbaren Klick einrasten, sodass Sie sicher sein können, dass das Gehäuse auf beiden Seiten ordnungsgemäß geschlossen ist.



Im Notfall (Gebrauch des AED)

SC1310: Drücken Sie die rote Taste (siehe Anweisungen auf dem Gehäuse), warten Sie, bis die Halterung ihren tiefsten Punkt erreicht hat, und entnehmen Sie den AED. SC1415: Stecken Sie den Schlüssel in das Schloss rechts unter der Halterung (siehe Anweisungen auf dem Gehäuse) und drehen Sie den Schlüssel kräftig nach rechts.



Warten Sie, bis die Halterung ihren tiefsten Punkt erreicht hat, und entnehmen Sie den AED.

SC1420: Drücken Sie die rote Taste (siehe Anweisungen auf dem Gehäuse), warten Sie, bis die Halterung ihren tiefsten Punkt erreicht hat, und entnehmen Sie den AED.

SC1320/ 1340/ 1435: Geben Sie den programmierten Code ein oder stecken Sie den Schlüssel in das Schloss rechts unter der Halterung und drehen Sie diesen kräftig nach rechts (siehe Anweisungen auf dem Gehäuse). Warten Sie, bis die Halterung ihren tiefsten Punkt erreicht hat, und entnehmen Sie den AED (Code und Schlüssel müssen im Notfall verfügbar sein).



Wichtig

Der Code, Schlüssel und SMS-Code müssen im Falle eines Notfalls jederzeit verfügbar sein (gilt für SC1435). Aufgrund eines unerwarteten Defekts kann eine der Öffnungsmethoden fehlschlagen. In diesem Fall muss eine Alternative verfügbar sein. Darüber hinaus ist es wichtig, die vorstehenden Verfahren vor der Lagerung des AED einzuüben und dies auch nach dessen Installation zu tun.

Wartung und Problemlösung



Wartung

Es ist wichtig, dass das SixCase Wandgehäuse wöchentlich geöffnet und geschlossen wird, um sicherzustellen, dass die Verschlusssysteme und Elektronik ordnungsgemäß funktionieren. Hierbei sollten Sie besonders auf die korrekte Funktion des Druckknopfs, des Eingabefelds, der Schlösser, des Rotor-Verschlusssystems und, wenn möglich, den Zustand des AED (bitte AED-Handbuch zurate ziehen) achten. Nachdem Sie fest auf den roten Druckknopf gedrückt, den Schlüssel eingesteckt oder den Code eingegeben haben, sollte sich der Boden des Gehäuses allmählich in einer flüssigen Bewegung nach unten bewegen, um den Zugang zum AED freizugeben.

Es ist ebenso wichtig, das Gehäuse auf der Außenseite

auf Beschädigungen zu überprüfen, die dessen Funktion möglicherweise beeinträchtigen können. Wenn das Gehäuse mit einem elektronischen Verschlusssystem ausgestattet ist, wird der Motor einmal täglich automatisch überprüft.

Um externe Fehlerströme abzuleiten, muss das Gehäuse geerdet sein.

Sollten Sie einen Defekt entdecken, wenden Sie sich unverzüglich an Ihren Händler oder direkt an SixCase. Je nach Defekt kann es empfehlenswert sein, den AED zu entfernen und die Benutzer in Kenntnis zu setzen (defekt).

Temperatur

Wenn Sie Zweifel an der Funktion der Heizapparatur haben (Außentemperatur unter 0 °C (32 °F)), entfernen Sie den Defibrillator und nehmen Sie Kontakt zu Ihrem Händler oder SixCase auf.

Der SC1330/ 1340/ 1415/ 1420/ 1435 ist mit einem aktiven Belüftungssystem ausgestattet. Bei ungefähr 30 °C wird der Ventilator eingeschaltet, um die Wärme aus dem oberen Teil zu lassen und kalte Luft über den Boden anzuziehen. Dennoch empfehlen wir, das Gehäuse an einem schattigen Ort aufzuhängen, um zu hohe Temperaturen zu vermeiden (über 50 °C).

CODE ändern

Öffnen Sie das SixCase-Gehäuse mit dem Schlüssel oder Werkscode (1234). Geben Sie den Code 1245 ein, um den Code zu ändern. Der Alarm wird deaktiviert.

Geben Sie den neuen Code ein und bestätigen Sie diesen mit dem grünen V. Der Alarm wird erneut aktiviert.

Ihr Code wurde geändert.

Hinweis: Bestätigen Sie die Änderung des Codes immer, indem Sie das SixCase AED-Gehäuse mit dem neuen Code öffnen.


Austausch des Sicherheitsglases

Bevor Sie das Sicherheitsglas austauschen, müssen Sie das Gehäuse schließen. Stellen Sie sicher, dass alle Glassplitter aus dem Gehäuse entfernt wurden und die Funktion des



Schlosses nicht beeinträchtigen. Ziehen Sie den roten Knopf in Ihre Richtung und setzen Sie das Sicherheitsglas ein. Bringen Sie den Knopf anschließend vorsichtig in seine Ausgangsposition zurück, sodass das Glas nicht bricht.

Code ändern (SC1320/ 1340/1435): Werkscode für den SixCase: 1234

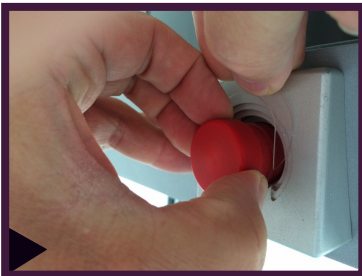

Problemlösung

Symptom	Korrektur
LED aus	Prüfen Sie die externe Stromversorgung (Stromversorgung und Adapter) Kontrollieren Sie die Kabel, indem Sie die Spannung im Gehäuse messen (12 V oder 24 V) Wenn das Gerät nicht funktioniert, nehmen Sie es außer Betrieb, entfernen Sie die Steuerung und kontaktieren Sie Ihren Händler oder SixCase.
Eingabefeld (Keypad) reagiert nicht	Prüfen Sie die externe Stromversorgung (Stromversorgung und Adapter) Kontrollieren Sie die Kabel, indem Sie die Spannung im Gehäuse messen (12 V oder 24 V) Wenn das Gerät nicht funktioniert, nehmen Sie es außer Betrieb, entfernen Sie die Steuerung und kontaktieren Sie Ihren Händler oder SixCase.
Gehäuse schließt nicht korrekt	Öffnen Sie das Gehäuse von Hand oder mit dem Code/ SMS. Drücken Sie den Boden des Gehäuses mit beiden Händen links und rechts nach oben. Beide Schösser (links & rechts) müssen mit einem hörbaren Klick einrasten, um zu bestätigen, dass das Gehäuse auf beiden Seiten geschlossen ist. Wenn das Gerät nicht funktioniert, nehmen Sie es außer Betrieb, entfernen Sie die Steuerung und kontaktieren Sie Ihren Händler oder SixCase.



Gehäuse lässt sich nicht auf beiden Seiten gleichmäßig öffnen (SC1310/1330/ 1420)	Schließen Sie das Gehäuse erneut Drücken Sie kräftiger auf den roten Knopf Wenn das Gerät nicht funktioniert, nehmen Sie es außer Betrieb, entfernen Sie die Steuerung und kontaktieren Sie Ihren Händler oder SixCase.
Eingabefeld reagiert, aber Gehäuse lässt sich nicht auf beiden Seiten gleichmäßig öffnen (SC1320/ 1340/ 1435)	Drücken Sie mit mäßigem Kraftaufwand gegen die untere Halterung. Wenn sich das Gehäuse öffnet, versuchen Sie es erneut mit dem üblichen Verfahren. Wenn sich das Gehäuse nicht öffnet, ist das Verschlussystem defekt oder es fehlt ein Teil. Nehmen Sie das Gerät außer Betrieb und kontaktieren Sie Ihren Händler oder SixCase.
Roter Druckknopf kann gedrückt werden, aber Gehäuse öffnet sich nicht (SC1310/1330/ SC1420)	Drücken Sie mit mäßigem Kraftaufwand gegen die untere Halterung. Wenn sich das Gehäuse öffnet, versuchen Sie es erneut mit dem üblichen Verfahren. Wenn sich das Gehäuse nicht öffnet, ist das Verschlussystem defekt oder es fehlt ein Teil. Nehmen Sie das Gerät außer Betrieb und kontaktieren Sie Ihren Händler oder SixCase.

Glossary

AED

AED (Automatischer Externer Defibrillator) ist ein tragbares Gerät welches gebraucht wird bei Personen mit Herzstillstand. Durch das andienen eines elektrischen Schocks kann dieser das Herz wieder in einen normalen Rhythmus bringen.

Verwalter

Für das Gehäuse und für den AED verantwortliche Person, deren Aufgabe es ist, den Zustand des AED und des Gehäuses zu überprüfen und die den Anweisungen in diesem Handbuch entsprechende Funktion zu gewährleisten.

Observer

Person welche einen SMS Bericht empfängt wenn der SixCase geöffnet wird.

GSM

Globales System für Mobile Kommunikation: abgeleitet von Groupe Special Mobile, ist der populärste Standard für mobile Telefonie weltweit.

SMS

Short Message Service (SMS) ist ein Kommunikationspro-

tokoll, welches das Auswechseln von Textberichten zwischen mobilen Telefonen möglich macht.



Verantwortlichkeit

GT Medicare ist in keiner Weise verantwortlich für die Installation, Kommunikation und dem Gebrauch der SixCase, der AED, und/oder entstandenen Schaden, welcher Art dann auch, an Dritten. Außergewöhnliche externe Bedingungen, wie niedrige Temperaturen, defekte Teile oder sonstige externe Einflüsse, können den AED betriebsunfähig machen. SixCase behält sich das Recht vor, dieses Dokument und alle in diesem Handbuch beschriebenen Produkte ohne vorherige Ankündigung anzupassen und zu verbessern. Der Inhalt dieses Dokuments wird unter Ausschluss jeder Garantie zur Verfügung gestellt.

Kontakt

GT Medicare BV

Bargelaan 6

2333 CT Leiden

Niederlande

Tel.: +031 (0) 71 2100 229

Email: info@sixcase.com



Table of contents

What is a SixCase?	30
General Description	30
For your safety	31
Conventions	31
Defects:	31
Important	31
Warranty	31
Product overview	32
What does the SixCase contain?	32
Installation	32
Important	32
Mounting on brick or concrete	32
Feeder cable	33
Be careful	33
Mounting on wood	33
Mounting the SixCase	33
Operation	33
In case of emergency (usage AED)	33
Important	33
Maintenance and Troubleshooting	34
Maintenance	34
Temperature	34
Changing code	34
Replacing the emergency glass	34
Troubleshooting	35
Glossary	36

What is a SixCase?

The AED (Automatic External Defibrillator) is an important device for primary help in case of a cardiac arrest. It is of a vital importance that the AED is protected, secured and available 24 / 7 for immediate assistance by an emergency. Our SixCase cabinet gives the ultimate protection and supplies day and night availability for the AED. The unique SMS module uses all modern communication.

The SixCase outdoor cabinet is designed to protect the AED against extreme weather conditions. The cabinet resists water, violence and mixes a proven concept with a modern design. Stainless steel or aluminium is cut by laser and welded by robot. A polycarbonate window gives a clear sight of the AED. Two hydraulic dampers lower the under part of the AED bracket after operating the lock. To maintain a temperature above 0°C, the outdoor SixCase is equipped with a temperature sensor and heater. The SixCase lock is based on a car principle, proven and solid.

General Description

Refer to page 1 and 2.



1. Control Unit (with LED lights, buzzer and fan. Pincode touchpad only for SC1435, SC1320, SC1340))
2. Safety instructions
3. Red push button
4. Rotor Latch Lock System (right)
5. AED Bracket (with heater SC1330, SC1340, SC1415, SC1420, SC1435)
6. Lock pin
7. LED lights
8. Power cable



For your safety

Conventions

Read the user manual carefully. All operators should review these safety considerations before placing the SixCase AED Cabinet into service. Not following the instructions may be dangerous or illegal. Follow all recommended maintenance instructions. If a problem occurs, obtain service immediately. Do not use the device until it has been inspected by appropriate personnel.

		Symbol
Warning:	Warning statements alert you to conditions or actions that can result in personal injury or death.	
Caution:	Caution statements alert you to conditions or actions that can result in damage to the unit.	

Defects:

All wireless devices may be sensitive to interferences. This may influence the functioning of the product. Only use and attach compatible products that are certified by SixCase.com.

Important

SixCase is neither responsible for the contents of this document nor for the loss of data, income, direct or indirect caused damage. SixCase preserves the right to adapt and to improve this document and all related products in this user manual, without preceding notification. The contents of this document are provided without any form of warranty.

Warranty

- GT MEDICARE is responsible for the quality of services and for the soundness and good quality of the products supplied to the best of its knowledge, with the proviso that the guarantee does not exceed the following provisions mentioned.
- If the defects are caused by purchaser the repair and shipping costs will be charged to purchaser.
- The purchaser is not entitled to warranty:
 - If the buyer has neglected the products.
 - If the buyer has made changes to the products or repairs which were not performed by or on behalf of GT MEDICARE.
 - When improper or careless use, incorrect connection, wrong voltage, lightning, damage due to moisture or other external products or misfortunes.
 - If the device is not in the usual or in the user prompt manner described to be maintained.
 - If the device is used with subordinate or wrong accessories.
 - If the buyer dealt with the goods with negligence.
- GT MEDICARE warrants that the Products do not contain serious defects at the time of delivery.
- Reseller will report defects, damages or non-conformity of the Products, which upon inspection can reasonably be determined, in writing to GT MEDICARE within 10 days after reception. Reseller will report all other defects in writing to GT MEDICARE within one year from the date of delivery. Products, which suggest that they are non-conforming or damaged, should be returned to GT MEDICARE immediately for inspection by GT MEDICARE. Claims, which were not reported according to the terms in this paragraph, will not be accepted. GT MEDICARE



will, in case of responsibility for the non-conformity or damage to the product, at its option, repair the Products, replace them with new ones or refund the purchase price of the Products. GT MEDICARE will have no other obligation or liability towards Reseller with respect to non-conforming or damaged products other than in the previous sentence displayed.

6. The duration of the warranty is 60 months for the wall cabinets, with scratches and damage to the cabinet and window outside this provision, and 24 months for the electronics from the time of delivery. The producer is only obliged to fulfil the obligations arising from this warranty. The producer is not liable for indirect or consequential damages. In all cases, the manufacturer's liability is limited to the selling price of the products sold.
7. Where a claim can be attributed to a modification or improper use of the product described in the contract the guarantee is under all circumstances not in force.
8. The recipient will investigate all received equipment immediately. The customer must inform GT MEDICARE in writing within ten (10) days after receipt of any defects in the consignment. If the deficiencies are not reported within a period of ten (10) days, the shipment was considered complete. For hidden, to prove by customer, defects, claims are only possible within the warranty period. If a complaint is justified by GT MEDICARE, then GT MEDICARE is only obliged to replace the defective goods or repair, without the customer being entitled to claim any compensation whatsoever. Submitting a claim does not relieve the customer from payment.

Product overview

What does the SixCase contain?

The SixCase contains the following parts:

- SixCase AED Wall Cabinet
- Key (optional)
- 24V Adapter (SC1320/ 1330/ 1340/ 1415/ 1420/ 1435)
- Feeding Cable 3m (SC1320/ 1330/ 1340/ 1415/ 1420/ 1435)
- Installation form
- Heater (SC1320/ 1330/ 1340/ 1415/ 1420/ 1435)
- GSM Module (SMS info pack)
- Organic plugs (4x)
- M8 dowel screws (4x)
- Spacer (4x)
- Rings (4x)
- Bolts (4x)

Installation

Important

The installation tools supplied are intended for mounting exclusively on flat surfaces of wood, brick or concrete. Panels must have a minimum thickness of 3mm. Always use the supplied spacers.

Mounting on brick or concrete

Place the supplied template against the wall and mark the holes. Drill the round 10 mm holes to a minimum depth of 60 mm, to ensure there is sufficient depth for the plug. We recommend drilling the upper holes at between 1.5 and 1.6 metres from the ground. The holes should always be drilled in the middle of the brick.



Feeder cable

SixCase also recommends drilling the 12 mm hole in such a way that the feeder cable can be led through the wall. It can then be attached to the 24V adapter, which should be placed inside the house or building. It is important to lead the feeder cable through the wall before mounting the case on this wall. The cable contains a connector that enables it to be attached to the SixCase. Lead the cable from the outside through the wall to the inside and then, from the inside, pull the cable until the connector touches the wall. The metric wire can be led through the hole and the SixCase is then ready to be mounted on the wall. After mounting it, using the four nuts, the connector can also be attached with a plastic wreck.

Be careful

If the wall is not very strong, we recommend to use Fischer VS 100P. After spraying the fluid into the holes, insert only the dowel screws – do not use the plugs again. Read the instructions on the Fischer label carefully and make sure that you clean the holes thoroughly after drilling.

Mounting on wood

Drill small holes of approximately 4 mm diameter in the wood and, using a tool, screw the dowel screws firmly into the wood and then mount the SixCase as instructed above. The screws should not extend more than 30 mm from the wooden surface. We recommend drilling the upper holes at a height of between 1.5 and 1.6 m from the ground.

Mounting the SixCase

Hang the SixCase on the dowel screws you have just installed in the wall and lock them with the four nuts from inside the cabinet. The nuts can be tightened using a fork spanner size 13. Be careful not to jam the feeder cable.

Operation

To close the cabinet, place both hands on the bottom left and right-hand sides of the cabinet and push upwards. Both locks (left & right) will then produce an audible click as confirmation that the cabinet is locked properly on both sides.



In case of emergency (usage AED)

SC1310: Push the red button (as shown on the instruction sticker), wait until the bracket has reached its lowest position and remove the AED.

SC1415: Insert key on the right under bracket (as shown on the instruction sticker) and turn the key powerfully to the right. Wait until the bracket has reached its lowest position and remove the AED.

SC1420: Push the red button (as shown on the instruction sticker), wait until the bracket has reached its lowest position and remove the AED.

SC1320/ 1340/ 1435: Enter the programmed code or insert key on the right and turn the key powerfully to the right (as shown on the instruction sticker), wait until the bracket has reached its lowest position and remove the AED (both code and key must be available in case of emergency).



Important

It is mandatory to always have the code, key and SMS code available in case of an emergency (applies to SC1435). Due to an unexpected defect it may happen that one of the openings procedures fails. In this case it is necessary to have an alternative available. Furthermore, it is important to rehearse the above mentioned procedures before storing the defibrillator, and frequently after having installed the AED.



Maintenance and Troubleshooting

Maintenance

It is vital to open and close the SixCase wall cabinet weekly to check that the lock systems and all electronic parts are working correctly. While doing so, you should take careful note of the correct operation of the push button, code keypad, key lock, the rotor latch lock and if possibly the status of the defibrillator (please check manual of AED). After pressing firmly on the red button, inserting the key or entering the code, the bottom part of the cabinet should gradually move downwards without any obstruction, thus providing access to the defibrillator. It is also important to check the external condition of the cabinet for any damage, which may possibly affect its operation. If the cabinet has an electrical locking system, it will be checked once a day automatically. To discharge any external currents, it is necessary to ground the cabinet. Upon discovering a defect, please contact your dealer or SixCase directly. Depending on the type of defect it may be advisable to remove the AED and inform the users about the status (unserviceable).

Temperature

If you have any doubt about the functioning of the heater (outside temperature lower than 0°C (32°F), please remove the defibrillator and contact your dealer or SixCase directly.

The SC1330/ 1340/ 1415/ 1420/ 1435 are equipped with an active ventilation system. Around 30°C the fan will be switched on to release the heat from the upper part and sucking in cold air from the bottom. Nevertheless, we recommend installing the cabinet in the shadow to prevent high temperatures (above 50°C).

Changing code

Default code for accessing the SixCase: 1234

Changing the CODE: Open the SixCase cabinet using the key or default code (1234). Enter code 1245 in order to change the code, the alarm stops.

Enter new code and confirm with the green V, the alarm starts again.

Your code has been changed.

Note: Always confirm the code change by opening the SixCase AED cabinet using the new code.

Replacing the emergency glass

Before replacing the safety glass, close the cabinet. Ensure that old glass remains are removed and not impede the function of the lock. Pull the red button towards you and install the safety glass. Then accompany the red button quiescently to its original position, so that the glass does not break.





Troubleshooting

Symptom	Corrective Action
LED Lights are out	<p>Check external power (power supply and adapter)</p> <p>Check cables by measuring power inside the cabinet (12 or 24 Volts)</p> <p>If the unit continues to fail, take it out of service, remove the control unit and contact dealer or SixCase.</p>
Pin code touch pad does not react to input	<p>Check external power (power supply and adapter)</p> <p>Check cables by measuring power inside the cabinet (12 or 24 Volts)</p> <p>If the unit continues to fail, take it out of service, remove the control unit and contact dealer or SixCase.</p>
Cabinet is not closing correctly	<p>Open cabinet manually or by code/ SMS</p> <p>Place both hands on the bottom left and right-hand sides of the cabinet and push upwards</p> <p>Both locks (left & right) must produce an audible click as confirmation that the cabinet is locked properly on both sides.</p> <p>If the unit continues to fail, take it out of service and contact dealer or SixCase.</p>
Cabinet does not open on both sides equally (SC1310/1330/ 1420)	<p>Close cabinet again</p> <p>Use more force by pushing the red button</p> <p>If the unit continues to fail, take it out of service and contact dealer or SixCase.</p>
Pin code touchpad reacts but cabinet does not open on both sides equally (SC1320/ 1340/ 1435)	<p>Apply moderate force on the under bracket, if cabinet opens, retry normal procedure</p> <p>If cabinet does not open, the lock system is defect or a part is missing, take it out of service and contact dealer or SixCase.</p>
Red push button can be operated but cabinet does not open (SC1310/1330/ SC1420)	<p>Apply moderate force on the under bracket, if cabinet opens, retry normal procedure</p> <p>If cabinet does not open the lock system is defect or a part is missing, take it out of service and contact dealer or SixCase.</p>



Glossary

AED

The AED (Automatic External Defibrillator) is an important device for primary help in case of cardiac arrest. It is vital that the AED is protected, secured and available 24/7 for immediate assistance in an emergency.

Operator/ user

Person who is responsible for the cabinet and AED. His/ her duty is to check the status of the AED and Cabinet and assure operation complying to the directives as described in this manual.

GSM

Global System for Mobile Communications (the most suitable standard for mobile telephones).

SMS

Short Message Service (communication protocol that makes it possible to exchange text messages between mobile phones)

Online service

For more information or online help, please visit our website www.sixcase.com.

User Manual: The manual contains all necessary information about operating the SixCase. Updates are being published on our website.



Disclaimer: GT Medicare is in no way responsible for the availability or serviceability of the AED stored in the SixCase cabinet. GT Medicare is neither responsible for the installation, use or operation contents of this document nor for the loss of data, income, direct nor indirect caused damage to third parties. Exceptional external conditions, such as low temperatures, defect parts or other external elements may result in unserviceable AED's. SixCase preserves the right to adapt and to improve this document and all related products in this user manual, without preceding notification. The contents of this document are provided without any form of warranty.

Contact

GT Medicare BV

Bargelaan 6

2333 CT Leiden

The Netherlands

T +031 (0) 71 2100 229

E info@sixcase.com



Inhoudsopgave

Qu'est-ce qu'un coffret SixCase?	37
Description générale	37
Pour votre sécurité	38
Conventions	38
Défauts	38
Important	38
Garantie	38
Présentation du produit	39
Le coffret SixCase comprend les éléments suivants	39
Installation	39
Important	39
Montage sur la brique ou le béton	39
Câble d'alimentation	40
Montage sur bois	40
Montage du coffret SixCase	40
Clef	40
Utilisation	40
En cas d'urgence (utilisation DEA)	40
Entretien et dépannage	41
Entretien	41
Température	41
Modification du code (SC1320/ 1340/1435)	41
Remplacement du verre de sécurité	41
Dépannage	42
Lexique	43

Qu'est-ce qu'un coffret SixCase?

Le DEA (défibrillateur externe automatisé) est un dispositif important en cas d'arrêt cardiaque. Il est d'une importance vitale que le DEA soit protégé, sécurisé et disponible 24h/24 7j/7 pour une assistance immédiate en cas d'urgence. Notre coffret SixCase donne une protection optimale et permet une disponibilité du DEA nuit et jour. Le coffret extérieur SixCase est conçu pour protéger le DEA contre les conditions climatiques extrêmes. Le coffret résiste à l'eau, à la violence et possède un design moderne. L'aluminium est découpé par laser et soudé par robotisation. Une fenêtre en polycarbonate donne une vue claire du DEA. Deux amortisseurs hydrauliques font descendre la partie inférieure de la console DEA après actionnement de la serrure. Pour maintenir une température au-dessus de 0°C, le coffret SixCase extérieur est équipé d'un capteur de température et d'un élément chauffant. La serrure du coffret SixCase est solide.

Description générale

Reportez-vous à la page 1 et 2

1. Unité de commande (avec lumière, alarme sonore, ventilateur et code tactile) (Seulement SC1435, SC1320, SC1340))
2. Consignes de sécurité
3. Bouton rouge
4. Rotor de verrouillage du système de fermeture (à droite)
5. Support de DEA (avec chauffage SC1330, SC1340, SC1415, SC1420, SC1435)
6. Tige de fermeture
7. Lumière LED
8. Câble d'alimentation



Pour votre sécurité

Conventions

Lire attentivement le manuel. Tous les utilisateurs doivent prendre connaissance des consignes de sécurité avant de mettre le coffret SixCase en service. Suivez les instructions pour éviter tout danger et être dans la légalité ainsi que les instructions d'entretien recommandées. Si un problème survient, consultez le fabricant dès que possible. Ne pas utiliser l'appareil jusqu'à ce qu'il ait été inspecté par un personnel compétent.

		Symbole
Avertissement:	Les avertissements vous informent des situations ou actions qui peuvent entraîner des blessures ou la mort.	
Attention:	Les mises en garde vous signalent les conditions ou les actions qui peuvent causer des dommages à l'unité.	

Défauts

Tous les appareils sans fil peuvent être sensibles et provoquer des interférences. Cela peut influencer le fonctionnement de l'appareil. Utiliser et fixer des produits compatibles qui sont certifiés par SixCase.com.

Important

GT Medicare n'est en aucun cas responsable de l'installation et de l'utilisation du coffret ou de la perte de données ou de dommage direct ou indirect causé à des tiers ou en cas de conditions extérieures exceptionnelles, comme des basses températures, des pièces défectueuses ou d'autres éléments externes pouvant rendre inutilisable le DEA.

GT Medicare se réserve le droit d'adapter et d'améliorer ce document et tous les produits liés à ce mode

d'emploi, sans notification préalable. Le contenu de ce document est fourni sans aucune forme de garantie.

Garantie

- GT Medicare est responsable de la qualité des services et de la solidité et de la bonne qualité des produits fournis dans la limite de ses possibilités, à la condition que la garantie ne dépasse pas les dispositions ci-après mentionnés.
- Si les défauts sont causés par l'acheteur, les réparations et frais d'expédition seront facturés à l'acheteur.
- L'acheteur n'a pas le droit à la garantie :
 - A: En cas de négligence du coffret par l'acheteur
 - B: Si l'acheteur a apporté des modifications au produit en cas de réparations qui n'ont pas été effectuées par ou au nom de GT Medicare.
 - C: Dans le cas d'une utilisation inappropriée ou négligente, une connexion incorrecte, mauvaise tension, la foudre, les dommages dus à l'humidité ou d'autres produits.
 - D: Si le coffret n'a pas été utilisé de façon correcte ou suivant le manuel d'utilisation.
 - E: Si l'appareil est utilisé avec des accessoires défectueux.
 - F: Si l'acheteur utilise le produit avec négligence.
- La société GT Medicare garantit que les produits ne contiennent pas de défauts graves au moment de la livraison.
- L'acheteur doit signaler les défauts, les dommages ou la non-conformité des produits, qui lors d'une inspection peuvent être raisonnablement déterminés, par écrit à GT Medicare dans les 10 jours après réception. L'acheteur doit signaler tous les autres défauts par écrit à GT Medicare dans un délai d'un an à partir de la date de livraison. Les



pièces qui semblent non conformes ou endommagées, doivent être retournées pour inspection à GT Medicare. Les réclamations qui n'ont pas été déclarées selon les termes de ce paragraphe, ne seront pas acceptées. GT Medicare, en cas de responsabilité pour la non-conformité ou de détérioration du produit, a le choix de réparer les produits, de les remplacer par des neufs ou de rembourser le prix d'achat des produits. GT Medicare n'aura pas d'autre obligation ou responsabilité à l'égard de l'acheteur en matière de non-conformité ou produits endommagés autres que dans le paragraphe ci-dessus.

6. La durée de la garantie sur toutes les pièces mécaniques est de 24 mois pour les coffrets de SC1300, les égratignures et les dommages extérieurs subits par le coffret et la fenêtre n'entrent pas dans cette disposition, et de 24 mois pour les appareils électroniques à partir du moment de la livraison. Le producteur est obligé uniquement de remplir les obligations découlant de la présente garantie. Le producteur n'est pas responsable des dommages indirects ou les conséquences de ceux-ci. Dans tous les cas, la responsabilité du fabricant est limitée au prix de vente des produits vendus.
7. Si une réclamation peut être attribuée à une modification ou une mauvaise utilisation du produit par l'acheteur décrit dans le contrat la garantie, celle-ci est dans tous les cas sans vigueur.
8. L'acheteur doit vérifier immédiatement tous les équipements reçus. Le client doit informer GT Medicare par écrit, dans les dix (10) jours suivant la réception, de tous les défauts de l'envoi. Si les irrégularités ne sont pas signalées dans un délai de dix (10) jours, l'envoi a été considéré comme approuvé. Si une réclamation est acceptée par GT Medicare alors GT Medicare est seulement

obligé de remplacer ou réparer les pièces défectueuses, le client ne peut pas prétendre à une quelconque indemnisation. La présentation d'une demande ne dispense pas le client de paiement.

Présentation du produit

Merci d'avoir acheter SixCase.

Le coffret SixCase comprend les éléments suivants

- Coffret SixCase
- Clef (facultatif)
- Adaptateur 24V (SC1320/ 1330/ 1340/ 1415/ 1420/ 1435)
- Alimentation 3m de câble (SC1320/ 1330/ 1340/ 1415/ 1420/ 1435)
- Notice d'installation
- Chauffage (SC1320/ 1330/ 1340/ 1415/ 1420/ 1435)
- Module GSM (SMS info pack)
- Cheville (4x)
- M8 vis de merrains (4x)
- Rondelles (4x)
- Entretoises (4x)
- M8 Boulons (4x)

Installation

Important

Les outils d'installation livrés sont destinés à monter le coffret exclusivement sur des surfaces planes en bois, brique ou béton. Les panneaux doivent avoir une épaisseur minimum de 3 mm. Toujours utiliser les entretoises fournies.

Montage sur la brique ou le béton

Placez le gabarit fourni contre le mur et marquer les trous. Percez des trous de 10 mm de diamètre à une profondeur minimale de 60 mm, pour être sûr qu'ils soient suffisamment profonds pour la fiche.



Nous vous recommandons de percer les trous supérieurs entre 1,5 et 1,6 mètres du sol. Les trous doivent être percés toujours au milieu de la brique.

Câble d'alimentation

GT Medicare recommande également de percer le trou de 12 mm de manière à ce que le câble d'alimentation puisse être dirigé à travers la paroi. Il peut alors être fixé à l'adaptateur 24 V, qui doit être placé à l'intérieur de la maison ou du bâtiment. Il est important de faire passer le câble d'alimentation à travers la paroi avant de monter le coffret sur ce mur.

Le câble comporte un connecteur qui lui permet d'être attaché au coffret SixCase. Introduire le câble de l'extérieur à travers la paroi à l'intérieur, puis, à partir de l'intérieur, tirer le câble jusqu'à ce que le connecteur touche le mur. Le fil métrique peut être conduit à travers le trou et le coffret est alors prêt à être monté sur le mur. Après le montage, en utilisant les quatre écrous, le connecteur peut également être attaché avec une épave en plastique.

Attention

Si le mur n'est pas très solide, nous recommandons d'utiliser Fischer VS 100P. Après la pulvérisation du liquide dans les trous, insérez uniquement les vis – dans ce cas, ne pas utiliser de chevilles. Lisez attentivement les instructions sur l'étiquette Fischer et assurez-vous de nettoyer les trous à fond après le forage.

Montage sur bois

Percez de petits trous d'environ 4 mm de diamètre dans le bois et, à l'aide d'un outil, vissez l'écoute électronique fermement dans le bois, puis monter le coffret comme indiqué ci-dessus. Les vis ne doivent pas dépasser de plus de 30 mm de la surface en bois. Verrouillez le coffret à nouveau avec les quatre vis. Nous vous recommandons de percer les trous supérieurs à une hauteur comprise entre 1,5 et 1,6 m du sol.

Montage du coffret SixCase

Fixer le coffret sur les fils de dérivation que vous

venez d'installer dans le mur et bloquer avec les quatre écrous de l'intérieur du coffret. Les écrous peuvent être serrés avec une clé à fourche n° 13. Veillez à ne pas coincer le câble d'alimentation.

Clef

La clef vous permettra d'ouvrir le coffret sans casser le verre ou l'activation du système de verrouillage en option. Elle vous permettra d'avoir toujours accès au défibrillateur en cas d'urgence ou pour des raisons de maintenance. Pour ouvrir le coffret SixCase, tournez la clé vers la gauche et appuyez simplement sur le cylindre noir à l'intérieur du bouton rouge.

Utilisation

Pour fermer le coffret, placez les deux mains sur les côtés gauche et droit du coffret et pousser vers le haut. Les deux serrures (gauche et droite) produiront ensuite un dé clic pour confirmer que le coffret est correctement verrouillé des deux côtés.



En cas d'urgence (utilisation DEA)

SC1310/ 1330: Appuyez sur le bouton rouge (comme indiqué sur l'étiquette d'instruction), attendre jusqu'à ce que le support ait atteint sa position la plus basse et enlever le DEA.
 SC1415: Insérer la clé sur la droite du support de DAE (comme indiqué sur l'étiquette d'instruction) et tourner la puissamment vers la droite. Attendre jusqu'à ce que le support ait atteint sa position la plus basse et enlever le DEA.
 SC1420: Appuyez sur le bouton rouge (comme indiqué sur l'étiquette d'instruction), attendre jusqu'à ce que le support ait atteint sa position la plus basse et enlever le DEA.
 SC1320/ 1340/ 1435: Entrez le code programmé (ou insérer la clé sur la droite et tourner la clé puissamment vers la droite), attendre jusqu'à ce que le support ait atteint sa position la plus basse et enlever le DEA (à la fois le



code et la clé doivent être disponibles en cas d'urgence).



Important

En raison d'un défaut inattendu, il se peut que l'une des procédures d'ouverture échoue. Dans ce cas, il est nécessaire d'avoir une alternative disponible. En outre, il est important de répéter les procédures mentionnées ci-dessus avant de ranger le défibrillateur, et souvent après avoir installé le DEA pour vérification.

Entretien et dépannage



Entretien

Il est essentiel d'ouvrir et de fermer le coffret SixCase de façon hebdomadaire afin de vérifier que les systèmes de verrouillage et tous les composants électroniques fonctionnent correctement. Ce faisant, vous devez prendre note du bon fonctionnement du bouton-poussoir, clavier à code, serrure à clé, la serrure de verrouillage du rotor et éventuellement l'état du défibrillateur (il est conseillé de vérifier manuellement le DEA). Ensuite, appuyez fermement sur le bouton rouge, en insérant la clé ou la saisie du code, la partie inférieure de l'armoire doit progressivement se déplacer vers le bas sans aucune obstruction, permettant ainsi l'accès au défibrillateur. Il est également important de vérifier l'état extérieur du coffret de tout dommage, qui peut éventuellement affecter son fonctionnement. Si le coffret dispose d'un système de verrouillage électrique, le moteur sera vérifié une fois par jour automatiquement. En cas de présence de courants externes, il est nécessaire de les décharger en plaçant le coffret à terre. Lors de la découverte d'un défaut, contactez votre revendeur ou directement GT Medicare. Selon le type de défaut, il peut être conseillé de retirer le DEA et d'informer les utilisateurs sur le statut inutilisable.

Température

Si vous avez un doute sur le fonctionnement de l'appareil de chauffage (température extérieure inférieure à 0°C (32°F)), éteignez le défibrillateur et contactez votre revendeur.

Le SC1330/ 1340/ 1415/ 1420/ 1435 sont équipés d'un système de ventilation actif. Autour 30°C le ventilateur se met en marche pour libérer la chaleur de la partie supérieure et la succion de l'air froid par le bas. Néanmoins, nous vous recommandons d'installer le coffret à l'ombre pour éviter des températures élevées (au-dessus 50°C).

Modification du code (SC1320/ 1340/1435)

Le code par défaut pour accéder à la SixCase est le: 1234 Ouvrez le coffret SixCase en utilisant le code clé ou par défaut (1234).

Entrez le code 1245 afin de modifier le code, l'alarme s'arrête.

Entrez le nouveau code et confirmer le avec le V vert, l'alarme se déclenche à nouveau.


Votre code a été changé.

Remarque: Toujours vérifier que la modification du code en ouvrant le coffret SixCase a été effectuée en utilisant le nouveau code.

Remplacement du verre de sécurité

Avant de remplacer le verre de sécurité, fermer le coffret. S'assurer que l'ancien verre soit enlevé pour ne pas entraver le fonctionnement de la serrure.

Tirer le bouton rouge vers vous et installez le verre de sécurité. Puis remettre le bouton rouge à sa position initiale, de sorte que le verre ne se brise pas.

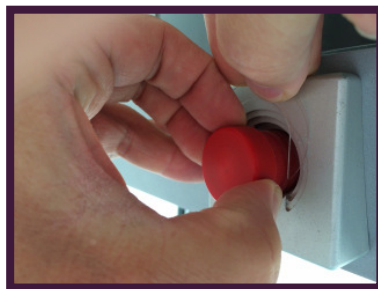

Depannage

Défaut	Action
Lumières éteints	Vérifiez l'alimentation externe (alimentation et adaptateur) Vérifier les câbles de mesure de la puissance dans le coffret (12 ou 24 Volts) Si l'opération continue d'échouer, mettre sur hors service et retirer l'unité de contrôle puis contacter votre détaillant ou GT Medicare.
Si le code tactile ne réagit pas à l'entrée	Vérifiez l'alimentation externe (alimentation et adaptateur) Vérifier les câbles de mesure de la puissance dans le coffret (12 ou 24 Volts) Si l'opération continue d'échouer, mettre sur hors service et retirer l'unité de contrôle puis contacter votre détaillant ou GT Medicare.
Le coffret ne se ferme pas correctement	Coffret ouvert manuellement ou par code Placez les deux mains sur le bas à gauche et à droite sur les côtés du coffret et pousser vers le haut Les dispositifs de verrouillage (gauche et droite) doivent produire un déclic pour confirmer que le coffret est correctement verrouillé des deux côtés. Si l'opération continue d'échouer, mettre sur hors service et retirer l'unité de contrôle puis contacter votre détaillant ou GT Medicare.
Le coffret ne s'ouvre pas sur les deux côtés (SC1310/1330/ 1420)	Fermer le coffret à nouveau Utilisez plus de force en appuyant sur le bouton rouge Si l'opération continue d'échouer, éteindre l'appareil et contacter votre détaillant ou GT Medicare.
Le code tactile réagit mais le coffret ne s'ouvre pas sur les deux côtés (SC1320/ 1340/ 1435)	Appliquer une force modérée sur le support inférieur, si le coffret s'ouvre, recommencez la procédure normale Si le coffret ne s'ouvre pas, le système de verrouillage est défectueux ou une pièce est manquante, l'éteindre et contactez votre détaillant ou GT Medicare.



Si le bouton-poussoir rouge ne fonctionne pas et que le coffret ne s'ouvre pas (SC1310/ 1330/ 1420/ 1710)

Appliquez une force modérée sur le support inférieur, si le coffret s'ouvre, recommencez la procédure normale

Si le coffret ne s'ouvre pas, le système de verrouillage est défectueux ou une pièce est manquante, l'éteindre et contacter votre détaillant ou GT Medicare.

Lexique

DEA

Le DEA (défibrillateur externe automatisé) est un dispositif important en cas d'arrêt cardiaque. Il est essentiel que le

DEA soit protégé, sécurisé et disponible 24h/24 7j/7 pour une assistance immédiate dans une situation d'urgence.

Opérateur / utilisateur

La personne responsable du coffret doit vérifier l'état du DEA et de s'assurer du fonctionnement conforme aux directives de la manière décrite dans ce manuel.

GSM

Global System for Mobile communications.

SMS

Short Message Service

Service en ligne

Pour plus d'informations ou de l'aide en ligne, veuillez visiter notre site web www.sixcase.com.

Mode d'emploi: Le manuel contient toutes les informations nécessaires sur le fonctionnement du coffret SixCase.

Les mises à jour sont publiées sur notre site web.

comme des basses températures, des pièces défectueuses ou d'autres éléments externes pouvant rendre inutilisable le DEA. GT Medicare se réserve le droit d'adapter et d'améliorer ce document et tous les produits liés à ce mode d'emploi, sans notification préalable. Le contenu de ce document est fourni sans aucune forme de garantie.

Contact

GT Medicare BV

Bargelaan 6

2333 CT Leiden

Pays-Bas

T +031 (0) 71 2100 229

E info@sixcase.com



Avertissement

GT Medicare n'est en aucun cas responsable de l'installation et de l'utilisation du coffret ou de la perte de données ou de dommage direct ou indirect causé à des tiers ou en cas de conditions extérieures exceptionnelles,



Inhoudsopgave

Wat is een SixCase?	44
Algemene beschrijving	44
Voor uw veiligheid	45
Waarschuwing	45
Storing	45
Belangrijk	45
Garantie	45
Productoverzicht	46
Wat zit er in de doos?	46
Installatie	47
Belangrijk	47
Bevestiging in steen of beton	47
Voedingskabel	47
Pas op	47
Bevestiging op hout	47
Ophangen van de SixCase	47
Gebruik	48
In geval van nood (gebruik AED)	48
Waarschuwing	48
Onderhoud en Troubleshooting	48
Onderhoud	48
Belangrijk	48
Temperatuur	48
Code programmeren (SC1320/ 1340/1435)	49
Breekglas vervangen	49
Troubleshooting	49
Glossary	50

Wat is een SixCase?

De AED (Automatische Externe Defibrillator) maakt inmiddels een belangrijk deel uit van de primaire hulpverlening. Het is daarbij van levensbelang dat de AED goed beveiligd, maar toch 24 /7 bereikbaar is. De SixCase geeft een optimale bescherming, beveiliging en zorgt voor een dag en nacht inzetbaarheid van de AED. De unieke SMS module maakt gebruik van moderne communicatiemiddelen (GSM, SMS) om de SixCase aan te sturen. Het unieke ontwerp van deze kast biedt goede bescherming aan de AED en is water bestendig. Om extreme weer omstandigheden te kunnen weerstaan is de SixCase uitgerust met een temperatuur sensor om zo een optimale temperatuur te creëren voor de AED.

Algemene beschrijving

Zie pagina 1 en 2.



1. Control Unit (met LED verlichting, alarm en ventilator, pincode touchpad (alleen voor SC1435, SC1320, SC1340))
2. Veiligheid instructies
3. Rode Drukknop
4. Rotor Latch Slotsysteem (rechts)
5. AED Beugel (met verwarming SC1330, SC1340, SC1415, SC1420, SC1435)
6. Lock pin
7. LED verlichting
8. Voedingskabel



Voor uw veiligheid

Waarschuwing

Lees het instructieboekje aandachtig door. Het niet opvolgen van de instructies kan gevaarlijk of onwettig zijn. Lees de volledige gebruikershandleiding voor meer informatie.

		Symbol
Gevaar:	Het gevarensymbool attendeert u op acties of situaties die kunnen leiden tot persoonlijk letsel.	
Waarschuwing:	Het gevarensymbool attendeert u op acties of situaties die kunnen leiden tot schade aan het apparaat of de omgeving.	

Storing

Alle draadloze apparaten kunnen gevoelig zijn voor storing. Dit kan de werking van het apparaat negatief beïnvloeden.

Belangrijk

SixCase is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit document nog voor het verlies van gegevens, inkomsten, directe en of indirecte schade hoe dan ook veroorzaakt. SixCase behoudt het recht om het document aan te passen of te verbeteren, geldende voor alle producten gepubliceerd in deze gebruikershandleiding, zonder voorafgaande kennisgeving.

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt als ook voor de toebehoren tot dit product.

Garantie

- GT MEDICARE staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde producten, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.
- Mochten de defecten veroorzaakt zijn door de koper dan zijn alle reparatie en verzendkosten voor diens rekening.
- De koper kan geen beroep doen op de garantiebepaling:
 - A: Indien de koper de producten heeft verwaarloosd.
 - B: Indien de koper wijzigingen aan de producten heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens GT MEDICARE zijn verricht.
 - C: Bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerken van vocht of door andere van buiten komende producten of onheilen.
 - D: Indien het apparaat niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruikersaanwijzing omschreven wijze is onderhouden.
 - E: Indien het apparaat wordt gebruikt met onderschikte of verkeerde accessoires.
 - F: Indien de koper de producten op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.
- GT MEDICARE garandeert dat de Producten geen ernstige gebreken bevatten op het moment van levering.
- Wederverkoper zal claims ter zake van gebreken, schade of non-conformiteit van de Producten die bij inspectie van de Producten redelijkerwijs kan



- worden vastgesteld, schriftelijk aan GT MEDICARE rapporteren binnen 10 werkdagen na ontvangst van de Producten op het terrein van Wederverkoper. Wederverkoper zal alle andere claims schriftelijk kenbaar maken aan GT MEDICARE binnen 1 jaar na de datum van levering. GT MEDICARE zal Producten waarvan Wederverkoper stelt dat zij non-conform of beschadigd zijn, op verzoek en op kosten van GT MEDICARE onverwijld terugzenden aan GT MEDICARE ten behoeve van inspectie door GT MEDICARE. GT MEDICARE zal claims die niet conform de in dit lid genoemde vereisten en binnen de in dit lid bedoelde termijnen worden gedaan, niet accepteren. GT MEDICARE zal, in geval hij verantwoordelijk is voor de non-conformiteit of schade aan het Product, naar eigen keuze de Producten repareren, vervangen door nieuwe Producten dan wel Wederverkoper de koopprijs voor de Producten retourneren. GT MEDICARE zal geen andere verplichting of aansprakelijkheid hebben jegens Wederverkoper met betrekking tot non-conforme of beschadigde Producten dan in de vorige zin weergegeven.
6. De duur van de garantie op de GT MEDICARE apparaten bedraagt 60 maanden op alle mechanische onderdelen van de wandkasten, waarbij krassen en beschadigingen buiten deze bepaling vallen en 24 maanden voor de elektronica en overige producten van GT Medicare vanaf het moment van levering, waarbij de algemene garantiebepalingen van GT MEDICARE, in Nederland, van toepassing zijn. Producent is slechts gehouden tot nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit deze garantiebepalingen. Producent is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van producent beperkt tot de verkoopprijs van de verkochte producten.
7. Wanneer een schadegeval terug te voeren is naar een wijziging of een ondeugdelijk gebruik van het in het contract omschreven product is de garantieregeling onder alle omstandigheden niet van kracht.
8. Elke apparatuurzending zal na ontvangst direct worden onderzocht door de ontvanger. De klant dient GT MEDICARE binnen tien (10) dagen na ontvangst schriftelijk te informeren over alle gebreken bij de zending. Indien deze gebreken binnen een periode van tien (10) dagen niet schriftelijk gemeld zijn, dan geldt tussen partijen dat de zending compleet was. Voor verborgen, dit te bewijzen door de klant, gebreken geldt dat reclames alleen mogelijk zijn binnen de garantietermijn. Indien een reclame door GT MEDICARE gegrond wordt bevonden, dan is GT MEDICARE uitsluitend verplicht de ondeugdelijke goederen te vervangen of te repareren, zonder dat de klant daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook. Het indienen van een reclame ontslaat de klant nimmer van zijn betalingsverplichtingen.

Productoverzicht

Wat zit er in de doos?

De SixCase bevat de volgende onderdelen:

- SixCase AED Wandkast
- Sleutel (optioneel)
- 24V Adapter (SC1320/ 1330/ 1340/ 1415/ 1420/ 1435)
- Voedingskabel 3m (SC1320/ 1330/ 1340/ 1415/ 1420/ 1435)
- Installatiemal
- Verwarming (SC1320/ 1330/ 1340/ 1415/ 1420/ 1435)
- GSM Module (SMS info pack)



- Bevestigingspluggen (4x)
- M8 stokeinden (4x)
- Afstandsbussen (4x)
- Ringen (4x)
- M8 moeren (4x)

Installatie

Belangrijk

Het correct installeren is van uiterst belang, en valt buiten de verantwoordelijkheid van SixCase. Het meegeleverde bevestigingsmateriaal is uitsluitend bedoeld voor installatie aan vlakke wanddelen bestaande uit massief hout, steen, beton of metalen platen met een minimale dikte van 3 mm. Het wordt afgeraden om de SixCase op lichtere metalen te plaatsen zoals bijvoorbeeld aluminium. Gebruik altijd de bijgeleverde afstandsbussen. Om de temperatuur in de kast beter te kunnen reguleren en voor behoud van kast en AED, adviseren wij de SixCase in de schaduw te plaatsen.

Bevestiging in steen of beton

Plaats de bijgeleverde mal (A4 formaat) op de muur en teken de gaten af. Boor de gaten van $\varnothing 10\text{mm}$ uiteen met een minimale diepte van 6cm (60mm), dit om voldoende inbouw lengte te creëren voor de plug of chemische mortel. De advieshoogte voor de bovenste gaten is ongeveer 1,5 M. De gaten moeten altijd in het midden van de steen worden geboord. Met een torxsleutel kan het stokeind onder de juiste voorspanning in de muur worden gedraaid. Het stokeind moet tot aan de metrische draad M8 in de muur worden bevestigd.

Voedingskabel

SixCase adviseert ook het middelste gat ($\varnothing 12\text{mm}$) te boren, zodat u de voedingskabel door de muur kunt laten lopen. Standaard wordt er een adapter en 3m voedingskabel bijgeleverd. Deze voedingskabel kan door middel van een connector aan de adapter worden bevestigd. Deze

connector kan door een gat van $\varnothing 12\text{mm}$. Het is belangrijk om de adapter binnen het pand te plaatsen. Alvorens de SixCase op te hangen is het belangrijk de voedingskabel door de muur te voeren. De kabel is voorzien van een wartel, waarmee de kabel ten opzichte van de SixCase gefixeerd kan worden. Voer de kabel van buiten door/over de muur naar binnen, tot de wartel tegen de muur komt. Vervolgens kan de SixCase aan de muur worden gehangen. Draai van binnenuit de kunststof moer vast en klik de connector boven in de moduleplaat en de SixCase is aangesloten.

Pas op

Indien blijkt dat de muur te zwak is om de SixCase met plug goed te kunnen bevestigen, adviseren wij Fischer VS 100 P. Het is dan voldoende om alleen de stokeind (zonder plug) in de mortel te draaien. Op de verpakking van Fischer VS 100 P staat de juiste gebruiksaanwijzing. Zorg ervoor dat u de gaten goed reinigt (1x uitblazen, 1x uitborstelen, 1x uitblazen, 1x uitborstelen) alvorens u de plug of chemische mortel in het boorgat stopt.

Bevestiging op hout

Boor met behulp van de bijgeleverde mal kleine gaatjes van $\varnothing 4\text{ mm}$ in het hout en draai vervolgens de stokeinden in het hout, laat het M8 stokeind maximaal 30mm uitsteken. Onze advieshoogte voor de bovenste gaten is ongeveer 1,5 M. Aan het einde van de M8 stokeind kan een sleutel worden geplaatst om de stokeind met een juiste voorspanning in het hout te draaien.

Ophangen van de SixCase

Hang de kast aan de stokeinden die u zojuist in de muur of in het hout heeft bevestigd. Vergrendel de SixCase door de bijgeleverde M8 moeren met sluitringen aan de binnenkant vast te draaien, handvast met sleutel 13. Zorg ervoor dat u de adapterkabel niet klemt!



Gebruik

Om de kast te sluiten, plaats beide handen links en rechts onder de onderbak en druk deze omhoog. Het goed sluiten van de kast wordt bevestigd door een hoorbare klik van beide sloten.

In geval van nood (gebruik AED)

SC1310: Sla op de rode knop (zoals aangegeven op de instructiesticker), wacht totdat de onderbak naar de onderste positie is gezakt en neem de AED uit.

SC1415: Steek de sleutel aan de rechterzijde in de onderbak (zoals aangegeven op de instructiesticker) en draai deze krachtig naar rechts. Wacht totdat de onderbak naar de onderste positie is gezakt en neem de AED uit.

SC1420: Sla op de rode knop (zoals aangegeven op de instructiesticker), wacht totdat de onderbak naar de onderste positie is gezakt en neem de AED uit.

SC1320/ 1340/ 1435: Toets de geprogrammeerde code in of steek de sleutel aan de rechterzijde in de onderbak (zoals aangegeven op de instructiesticker) en draai deze krachtig naar rechts. Wacht totdat de onderbak naar de onderste positie is gezakt en neem de AED uit (u moet zowel de code als de sleutel te allen tijde bij u hebben in geval van nood).

Waarschuwing

U moet te allen tijde de code, sleutel of SMS code bij u hebben in geval van nood. Door een onverwachte storing kan het voorkomen dat één van de openingsmethodes niet functioneert. In dit geval moet u een alternatief beschikbaar hebben. Het is belangrijk om de openingsprocedures te oefenen voordat de AED wordt geplaatst, maar ook daarna.

Onderhoud en Troubleshooting

Onderhoud

Het is belangrijk wekelijks de werking van de kast te controleren (openen) waaronder de drukknop of pincode touchpad, slotsysteem, sleutelcilinder en indien nodig de slot-onderdelen opnieuw te smeren (kogella-gervet of multi grease). Na het indrukken van de rode knop, het insteken van de sleutel of het intoesten van de geprogrammeerde code moet de onderbak gemakkelijk naar beneden zakken, zodat de AED kan worden uitgenomen. Indien mogelijk controleer ook de status van de AED volgens de bijgeleverde handleiding. Indien u een defect constateert adviseren wij u direct contact op te nemen met uw dealer of de fabrikant SixCase. Afhankelijk van het defect adviseren wij om de AED (tijdelijk) buiten werking te stellen.

Belangrijk

Om het goed functioneren van de SixCase te garanderen, is het alleen toegestaan om goed-gekeurde onderdelen te gebruiken. Om te zorgen dat eventuele externe lekstromen worden afgevoerd is het noodzakelijk de kast te aarden.

Temperatuur

Als u twijfelt aan de werking van de verwarming (bij temperaturen lager dan 0°C (32°F)) adviseren wij de AED uit te nemen en contact op te nemen met de dealer. De SC1330/ 1340/ 1415/ 1420/ 1435 kasten zijn uitgerust met een actief ventilatiesysteem. Bij een binnentemperatuur van +/- 30°C zal de ventilator in werking treden en warme lucht afvoeren. Via een ventilatieopening in de onderbak wordt er koelere lucht aangezogen om hoge temperaturen zoveel mogelijk te voorkomen. Bij temperaturen hoger dan 50°C adviseren wij u om de AED uit te nemen.

Code programmeren (SC1320/ 1340/1435)

Standaard ingestelde code voor het openen van de SixCase: 1234

Wijzigen van de pincode:

Open de SixCase wandkast door middel van de sleutel of de reeds ingestelde pincode (1234).

Toets de code 1245 om de pincode te kunnen wijzigen, het alarm stopt. Voer de nieuwe pincode in en bevestig deze met de groene V, u hoort opnieuw het alarm.

Uw code is gewijzigd.

Waarschuwing: Controleer altijd de gewijzigde pincode door de SixCase AED-wandkast te openen met de nieuwe pincode.

Breekglas vervangen

Om het breekglas te kunnen vervangen sluit u de kast. Controleer of oude glasresten de functie van het slot niet belemmeren. Trek vervolgens de rode knop naar u toe en plaats het breekglas.

Begeleid de rode knop rustig terug naar zijn oorspronkelijke positie, zodat het glas niet breekt.

**Troubleshooting**

Defect	Actie
LED verlichting brandt niet	<p>Controleer of de externe voeding goed is aangesloten (voedingskabel en adapter)</p> <p>Meet in de kast of er stroom aanwezig is (12 of 24 Volt)</p> <p>Indien de fout niet opgelost kan worden adviseren wij de kast en eventueel AED buiten dienst te stellen en contact op te nemen met uw dealer of SixCase.</p>
Pin code touch pad reageert niet op input	<p>Controleer of de externe voeding goed is aangesloten (voedingskabel en adapter)</p> <p>Meet in de kast of er stroom aanwezig is (12 of 24 Volt)</p> <p>Indien de fout niet opgelost kan worden adviseren wij de kast en eventueel AED buiten dienst te stellen en contact op te nemen met uw dealer of SixCase.</p>
Kast sluit niet correct	<p>Open de kast manueel of met de code</p> <p>Plaats beide handen links en rechts onder de onderbak en druk deze omhoog.</p> <p>Het goed sluiten van de kast wordt bevestigd door een hoorbare klik van beide sloten.</p> <p>Indien de fout niet opgelost kan worden adviseren wij de kast en eventueel AED buiten dienst te stellen en contact op te nemen met uw dealer of SixCase.</p>



Kast open niet geheel (één zijde) (SC1310/1330/ 1420)	Sluit de kast (volgens bovenstaande procedure) Gebruik meer kracht bij het slaan op de rode knop Indien de fout niet opgelost kan worden adviseren wij de kast en eventueel AED buiten dienst te stellen en contact op te nemen met uw dealer of SixCase.
Pincode touchpad reageert juist, maar kast open niet geheel (SC1320/ 1340/ 1435)	Voer matige druk uit op de onderbak Als de kast niet opent, sluit de kast opnieuw. Wij adviseren de kast en eventueel AED buiten dienst te stellen en contact op te nemen met uw dealer of SixCase.
Rode drukknop kan ingedrukt worden, maar kast open niet geheel (één zijde) (SC1310/1330/ 1420)	Voer matige druk uit op de onderbak Als de kast niet opent, sluit de kast opnieuw. Wij adviseren de kast en eventueel AED buiten dienst te stellen en contact op te nemen met uw dealer of SixCase.

Glossary

AED

AED (Automatic External Defibrillator) is een draagbaar toestel dat wordt gebruikt bij een persoon met een hartstilstand. Door het toedienen van een elektrische schok probeert men het hart weer een normaal ritme te geven.

Operator/ user

Dit is de hoofdgebruiker van de SixCase. Deze persoon heeft toegang tot gebruikersprofielen en zorgt voor het onderhoud van de AED kast.

GSM

Global System for Mobile communications: afgeleid van Groupe Special Mobile, is de meest populaire standaard voor mobiele telefoons wereldwijd.

SMS

Short Message Service (SMS) is een communicatie protocol dat uitwisseling van tekstberichten mogelijk maakt tussen mobiele telefoons.

Online service

Voor meer informatie of online service, bezoek onze website www.sixcase.com.

User Manual: De online gebruikershandleiding bevat de meest recente informatie van de SixCase. Updates worden op de website gepubliceerd.



Disclaimer

GT Medicare/ SixCase.com is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de installatie, communicatie en het gebruik van de SixCase AED kast en/of schade aan derden. Voor overige bepalingen, zie onze algemene voorwaarden.

Contact

GT Medicare BV
Bargelaan 6
2333 CT Leiden
The Netherlands
T +031 (0) 71 2100 229
E info@sixcase.com

SIXCASE.COM

Ready to improve?

